


Trousse d'amplicons personnalisés TruSeq Dx^{MD}

Formulaire de suivi de la trousse et du flux de travail

DESTINÉ AU DIAGNOSTIC *IN VITRO* DIAGNOSTIC UNIQUEMENT

Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la *Notice d'accompagnement de la trousse d'amplicons personnalisés TruSeq Dx* (document n° 1000000029772).

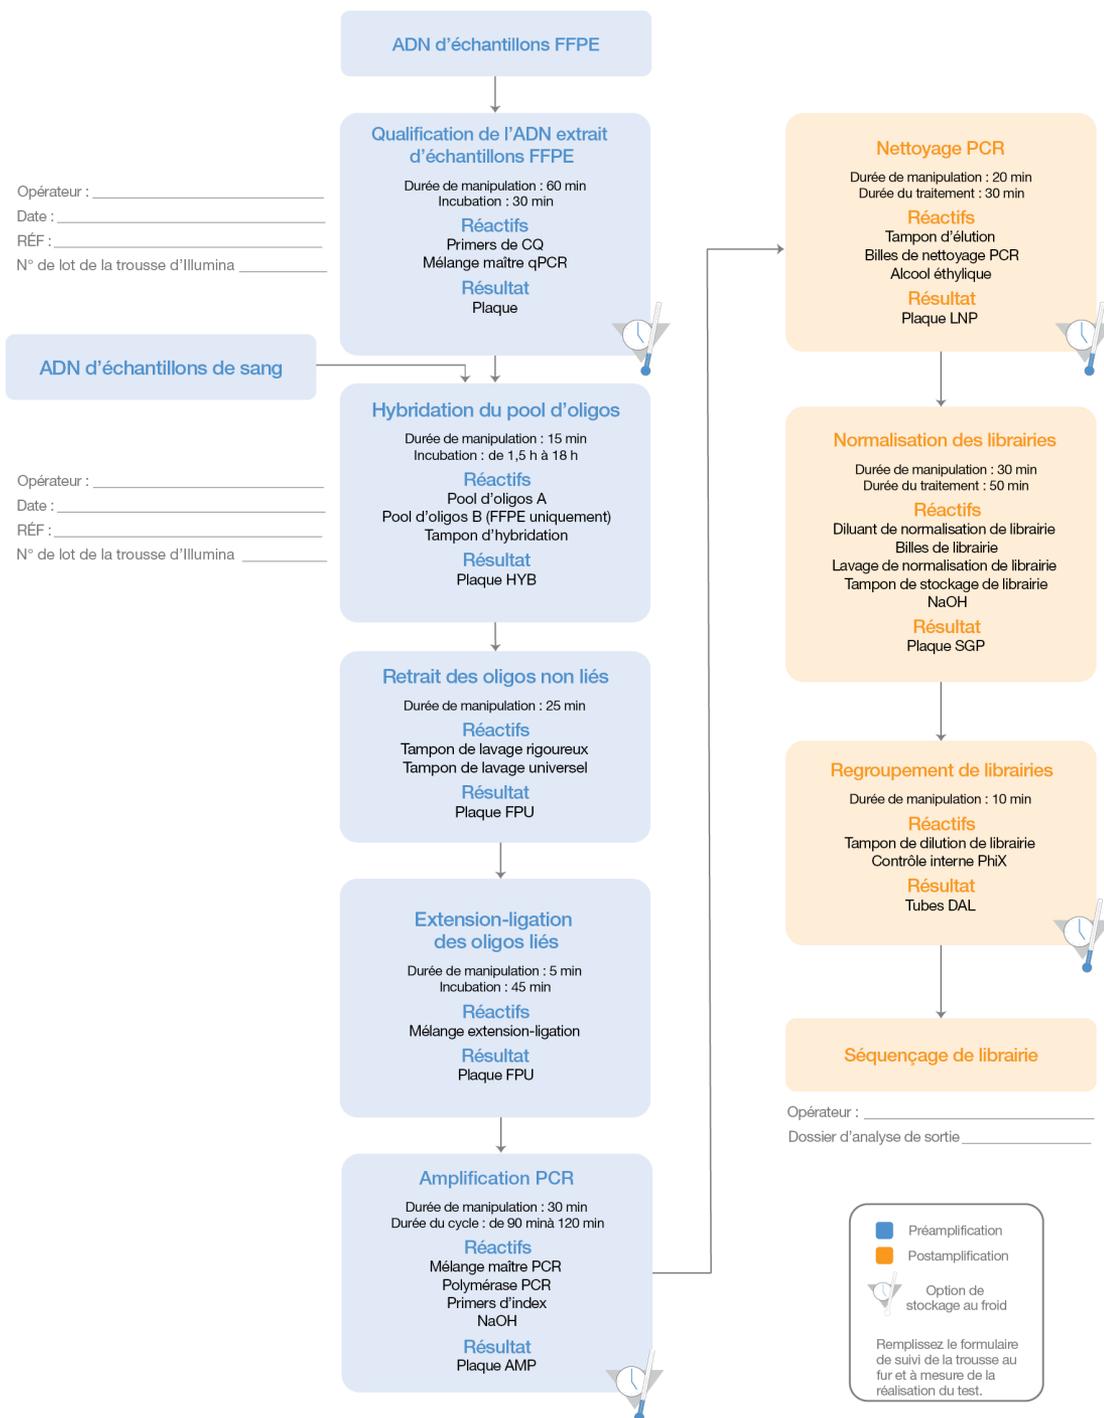

Test diagnostique de la trousse d'amplicons TruSeq personnalisée

Formulaire de suivi de la trousse et du flux de travail

[Cette page a été volontairement laissée vide.]



Illumina

5200 Illumina Way


San Diego, Californie 92122 États-Unis

+(1) 800 809-ILMN (4566)

+(1) 858 202-4566 (en dehors de l'Amérique du Nord)

techsupport@illumina.com

www.illumina.com



Illumina Cambridge Limited
Chesterford Research Park,
Little Chesterford
Saffron Walden, CB10 1XL
ROYAUME-UNI



Commanditaire
australien :
Illumina Australia
1 International Court
Scoresby, Victoria, 3179
Australie