


# iSeq 100

## Veiledning for sekvenseringssystem

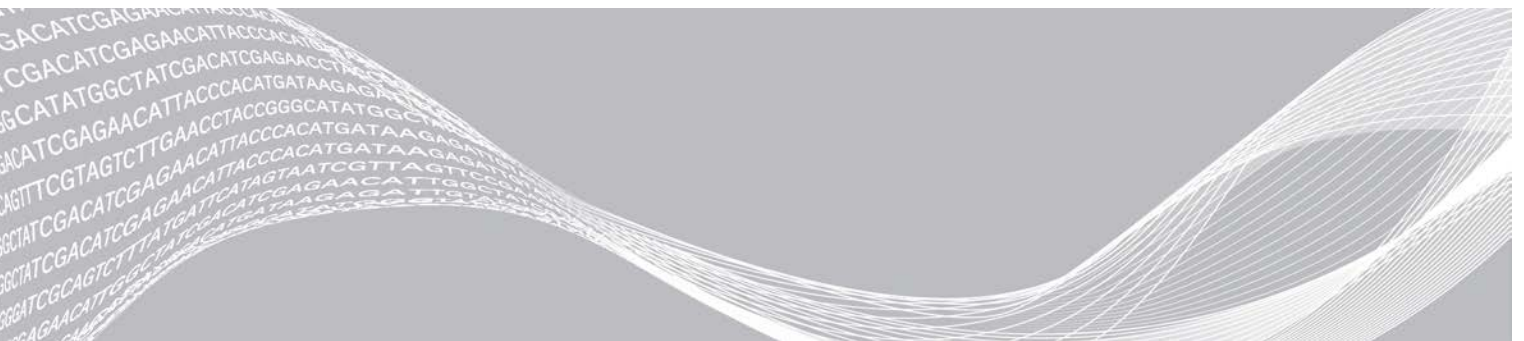

Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc. og tilknyttede selskaper («Illumina»), og er ment utelukkende for kontraktbruk av kunden i forbindelse med bruk av produktet (produktene) beskrevet her, og for intet annet formål. Dette dokumentet og dets innhold skal ikke brukes eller distribueres til andre formål og/eller på annen måte kommuniseres, fremlegges eller reproduseres på noen måte uten forutgående, skriftlig samtykke fra Illumina. Illumina overfører ikke noen lisens under sitt patent, varemerke, opphavsrett eller sedvanerett eller lignende rettigheter til tredjeparter gjennom dette dokumentet.

Instruksjonene i dette dokumentet skal følges strengt og tydelig av kvalifisert og tilfredsstillende utdannet personell for å sikre riktig og sikker bruk av produktet (produktene) som er beskrevet i dette dokumentet. Alt innhold i dette dokumentet skal leses fullt ut og være forstått før produktet (produktene) brukes.

HVIS DET UNNLATES Å LESE FULLSTENDIG OG UTTRYKkelig FØLGE ALLE INSTRUKSJONENE I DETTE DOKUMENTET, KAN DET FØRE TIL SKADE PÅ PRODUKTET (PRODUKTENE), SKADE PÅ PERSONER, INKLUDERT BRUKERE ELLER ANDRE, OG SKADE PÅ ANNEN EIENDOM, OG DETTE VIL UGYLDIGGJØRE EVENTUELL GARANTI SOM GJELDER FOR PRODUKTET (PRODUKTENE).

ILLUMINA PÅTAR SEG IKKE ANSVAR SOM FØLGE AV FEIL BRUK AV PRODUKTET (PRODUKTENE) SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET (INKLUDERT DELER AV DETTE ELLER PROGRAMVARE).

© 2019 Illumina, Inc. Med enerett.

Alle varemerker tilhører Illumina, Inc. eller deres respektive eiere. Ytterligere informasjon om varemerker finner du på [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

# Revisjonslogg

| Dokument                         | Dato            | Beskrivelse av endring   |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Dokumentnr.<br>1000000036024 v05 | Mars<br>2019    | <p>Oppdaterte programvarebeskrivelser i iSeq-kontrollprogramvare v1.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdaterte instruksjoner for konfigurasjon av systeminnstillinger, inkludert å flytte og gi enkelte brukergrensesnittelementer nytt navn.</li> <li>• La til beskrivelser av metrikk for %Clusters PF (% klynge-PF) og %Occupancy (% fyllingsgrad), som finnes i skjermbildet Sequencing (Sekvensering).</li> <li>• Tillot tilordnede nettverksstasjonsplasseringer for prøvearkene og utdatamappene.</li> <li>• Anga at programvaren automatisk gir prøveark det nye navnet <b>SampleSheet.csv</b>.</li> </ul> <p>La til koblinger på følgende sider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iSeq 100-systemprøvearkmalen for manuell modus.</li> <li>• Støttesidene for bcl2fastq-konverteringsprogramvare.</li> </ul> <p>La til volumer av 1 nM 100 % PhiX og AmpliSeq Library PLUS for Illumina-biblioteker for klargjøring.</p> <p>La til instruksjon om å flytte referansegenomdatabasen for Local Run Manager til en annen plassering enn stasjon C ved gjenoppretting av systemets fabrikkinnstillinger.</p> <p>Økte de maksimalt anbefalte syklusene for Index Read 1 (Indeksavlesning 1) og Index Read 2 (Indeksavlesning 2) til 10 sykluser hver.</p> <p>Økte antall sykluser som kassetten støtter til 322.</p> <p>Henviste til <i>Veiledning for klyngetetthetsoptimalisering (dokumentnr. 1000000071511)</i> med tanke på detaljert informasjon om optimalisering av lastekonsentrasjon.</p> <p>Klarla at en kassett som skal tines i et vannbad må oppbevares ved – 25 °C til –15 °C i minst én dag før tining.</p> <p>Korrigerte AmpliSeq for Illumina Library PLUS til AmpliSeq Library PLUS for Illumina.</p> |
| Dokumentnr.<br>1000000036024 v04 | Oktober<br>2018 | <p>Lagt til anbefalte lastekonsentrasjoner og fortynningsinstruksjoner for Nextera DNA Flex for Enrichment-, TruSeq DNA Nano- og TruSeq DNA PCR-Free-biblioteker.</p> <p>Lagt til informasjon om bruk av en normaliseringsmetode som ikke gir enkeltstrengede biblioteker.</p> <p>Lagt til beskrivelser av de to kjøeringsmodusene, Local Run Manager og Manuell.</p> <p>Lagt til et 5 % PhiX-anrikingsalternativ og definert formålet med hver prosentandel for anriking.</p> <p>Lagt til følgende trinn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bytter til sbsadmin-operativsystemkontoen når du installerer kontrollprogramvaren, analysemodulene og annen programvare.</li> <li>• Slå av og på instrumentet når du skal gjenopprette til fabrikkinnstillinger.</li> </ul> <p>Referanse til <i>Illumina-adaptersekvenser (dokumentnr. 1000000002694)</i> for å avgjøre Index 2 (Indeks 2) (i5)-retninger for et prøveark.</p> <p>Forklaringer av følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kassetter må brukes umiddelbart etter tining.</li> <li>• Lastekonsentrasjonene oppført for Nextera DNA Flex- og Nextera Flex for Enrichment-biblioteker gjelder ikke for andre Nextera-bibliotekstyper.</li> <li>• SureCell WTA 3' er ikke et kompatibelt bibliotek.</li> </ul>   |

| Dokument                         | Dato           | Beskrivelse av endring   |
|----------------------------------|----------------|--|
| Dokumentnr.<br>1000000036024 v03 | August<br>2018 | <p>Oppdaterte programvarebeskrivelser i iSeq-kontrollprogramvare v1.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La til konfigurasjonsinstruksjoner for Universal Copy Service.</li> <li>• Endret navnet på fanen Network Configuration (Nettverkskonfigurasjon) til Network Access (Nettverkstilgang).</li> <li>• La til instruksjoner om åpning av Local Run Manager fra kontrollprogramvaren.</li> </ul> <p>Oppdaterte standardplassering for utdatamappe til D:\SequencingRuns.<br/>La til instruksjoner om tilkobling av systemet til en proxy-server.<br/>La til krav om å angi en UNC-bane for utdatamappe- og prøvearkplasseringene i nettverket.<br/>Anga de unike kravene for konfigurasjon av en utdatamappeplassering på en intern stasjon, ekstern stasjon eller nettverksplassering.<br/>Laget instruksjoner om å opprette et prøveark for manuell modus i første trinn av kjøringssoppsett.<br/>Korrigerende instruksjoner og bruk av installasjonsveiviseren for systemserien.<br/>Korrigerende beskrivelsen av utdataminiatyrfiler.</p>  |
| Dokumentnr.<br>1000000036024 v02 | Juni<br>2018   | <p>Oppdaterte rør brukt for fortynning av biblioteker til Fisher Scientific katalognr. 14222158 eller tilsvarende rør med lav binding.<br/>La til en del som beskriver den regionale tilgjengeligheten for avansert bytte.<br/>Klarla at biblioteker fortynnet til lastekonsentrasjonen må sekvenseres samme dag.<br/>Klarla at reagenskassetten må tas ut av esken for tining.</p>  |
| Dokumentnr.<br>1000000036024 v01 | Mai<br>2018    | <p>Oppdaterte programvarebeskrivelser i iSeq-kontrollprogramvare v1.2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La til alternativ om å bla til et nedlastet installasjonsprogram for programvare fra kontrollprogramvaren.</li> <li>• La til instruksjoner om lagring av miniatyrbilder.</li> <li>• Flyttet nettverksinnstillinger til fanen Network Configuration (Nettverkskonfigurasjon).</li> <li>• Økte maksimal bruk av testkomponenter til flergangsbruk til 36, og bemerket at resterende antall ganger bruk vises på skjermen.</li> </ul> <p>Oppdaterte Local Run Manager-informasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La til trinn for åpning av Local Run Manager og oppsett av kjøringen.</li> <li>• La til RNA Amplicon som en forhåndsinstallert analysemodul, samt anriking og sekvensering av DNA på nytt som andre støttede moduler.</li> <li>• Oppdaterte dokumentasjonshenvvisninger til <i>Veiledning for Local Run Manager-programvare (dokumentnr. 1000000002702)</i>.</li> </ul> <p>Oppdaterte tineinstruksjoner for kassetter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La til et alternativ for tining ved romtemperatur.</li> <li>• Ga mer detaljerte instruksjoner om vannbad, deriblant oppbevaring før tining.</li> </ul> <p>Oppdaterte instruksjoner om klargjøring av biblioteker for sekvensering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdaterte lastekonsentrasjonen av Nextera DNA Flex til 200 pM.</li> <li>• La til startlastekonsentrasjon for bibliotektyper som ikke er oppgitt.</li> <li>• La til informasjon om metrikken % fyllingsgrad.</li> <li>• Økte volum på 1 nM PhiX for en anriking til 50 µl.</li> </ul> <p>Oppdaterte Illumina-katalognumre for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstra dryppbrettpute for iSeq 100 til 20023927.</li> <li>• Ekstra luftfilter for iSeq 100 til 20023928.</li> </ul> <p>Oppdaterte anbefalinger om dråpetellere og dråpetellerspisser.</p> |

| Dokument                                 | Dato                    | Beskrivelse av endring  |
|--|-------------------------|---|
| <p>Dokumentnr.<br/>1000000036024 v01</p> | <p>Mai<br/>2018</p>     | <p>La til følgende diverse instruksjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utføre valideringskjøringer.</li> <li>• Opprette et prøveark ved sekvensering i manuell modus.</li> <li>• Minimere kontrollprogramvaren for å oppnå tilgang til andre programmer.</li> </ul> <p>La til følgende trinn i fremgangsmåten for systemkontroll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laste ut og oppbevare testkomponenter til flergangsbruk.</li> <li>• Fjerne synlig smuss fra teststrømningscellen til flergangsbruk.</li> </ul> <p>Omorganiserte følgende innhold for å forbedre kontinuiteten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slo sammen instruksjoner for å utføre en kjøring kun med PhiX med standardinstruksjonene for sekvensering.</li> <li>• Slo sammen instruksjoner for klargjøring av strømningsceller med instruksjoner for bibliotekfortynning.</li> <li>• Konsoliderte instruksjoner for PhiX-anriking.</li> <li>• Flyttet informasjon om antall sykluser i en avlesning.</li> <li>• Flyttet sanntidsanalyse og kalte det <i>Sequencing Output</i> (Utdata for sekvensering) i stedet.</li> </ul> <p>Forenklet arbeidsflytdiagrammet for feilmeldinger.</p> <p>Fjernet informasjon om nettbrett- og skrivebordsmodi. Operativsystemet kjører i skrivebordsmodus som standard, og det er ikke behov for nettbrettmodus.</p> <p>Fjernet krav om å fylle ut og sende inn et dekontamineringssertifikat for avansert bytte.</p> <p>Korrigert gjennomsnittlig kjøringstørrelse til 2 GB.</p> |
| <p>Dokumentnr.<br/>1000000036024 v00</p> | <p>Februar<br/>2018</p> | <p>Første versjon.</p>  |

# Innholdsfortegnelse

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kapittel 1 Oversikt</b> .....                              | <b>1</b>  |
| Innledning .....  | 1         |
| Tilleggsressurser .....                                       | 2         |
| Instrumentkomponenter .....                                   | 3         |
| iSeq 100 i1-reagens .....                                     | 7         |
| <br>  |           |
| <b>Kapittel 2 Komme i gang</b> .....                          | <b>11</b> |
| Førstegangs oppsett .....                                     | 11        |
| Minimere kontrollprogramvaren .....                           | 11        |
| Kjøringsinnstillinger .....                                   | 12        |
| Instrumenttilpasning .....                                    | 14        |
| Nettverksoppsett .....  | 16        |
| Brukerlevert forbruksmateriell og utstyr .....                | 17        |
| <br>  |           |
| <b>Kapittel 3 Sekvensering</b> .....                          | <b>20</b> |
| Innledning .....  | 20        |
| Tine kassetten i pose .....                                   | 21        |
| Klargjøre strømningsscellen og bibliotekene .....             | 22        |
| Laste forbruksmateriell inn i kassetten .....                 | 24        |
| Konfigurere en sekvenseringskjøring (Local Run Manager) ..... | 26        |
| Konfigurere en sekvenseringskjøring (manuell modus) .....     | 29        |
| <br>  |           |
| <b>Kapittel 4 Vedlikehold</b> .....                           | <b>33</b> |
| Frigjøre plass på harddisken .....                            | 33        |
| Programvareoppdateringer .....                                | 33        |
| Skifte ut luftfilteret .....                                  | 35        |
| Flytte instrumentet .....                                     | 36        |
| Programvarebegrensningspolicyer .....                         | 38        |
| <br>  |           |
| <b>Vedlegg A Utdata for sekvensering</b> .....                | <b>41</b> |
| Oversikt over sanntidsanalyse .....                           | 41        |
| Arbeidsprosess for sanntidsanalyse .....                      | 43        |
| <br>  |           |
| <b>Vedlegg B Feilsøking</b> .....                             | <b>47</b> |
| Løse feilmeldinger .....                                      | 47        |
| Avbryte en startet kjøring .....                              | 48        |
| Foreta en strømtilstandsending for instrumentet .....         | 48        |
| Utføre en systemkontroll .....                                | 49        |
| Lekkasjebegrensning .....                                     | 51        |
| Gjenopprette til fabrikkinnstillinger .....                   | 54        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Vedlegg C Avansert bytte</b> .....            | <b>55</b> |
| Bytte iSeq 100-systemet .....                    | 55        |
| Motta et erstatningssystem .....                 | 55        |
| Klargjøre det originale systemet for retur ..... | 55        |
| Returnere det originale systemet .....           | 58        |
| <br>   |           |
| <b>Indeks</b> .....                              | <b>62</b> |
| <br>   |           |
| <b>Teknisk hjelp</b> .....                       | <b>68</b> |

# Kapittel 1 Oversikt

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Innledning .....            | 1 |
| Tilleggsressurser .....     | 2 |
| Instrumentkomponenter ..... | 3 |
| iSeq 100i1-reagens .....    | 7 |

## Innledning

Illumina® iSeq™ 100-sekvenseringssystem sørger for en målrettet tilnærming til neste generasjons sekvensering (NGS). Dette programfokuserede systemet pakker Illumina-sekvenseringsteknologi inn i et kostnadseffektivt skrivebordsinstrument.

## Funksjoner

- ▶ **Accessibility and reliability** (Tilgjengelighet og pålitelighet) – iSeq 100-systemet har en liten grunnflate og er enkelt å installere og bruke. Væske- og avbildningskomponenter er innebygd i forbruksmateriellet, noe som gjør det enklere å vedlikeholde instrumentet.
- ▶ **Single-step consumable loading** (Ettrinns innlasting av forbruksmaterie) – En kassett til engangsbruk er forhåndsfylt med alle reagenser som kreves for en kjøring. Bibliotek og en strømningscelle utstyrt med sensor lastes direkte inn i kassetten, som deretter lastes inn i instrumentet. Integrert identifisering muliggjør nøyaktig sporing.
- ▶ **iSeq 100-systemprogramvare** – En serie med integrert programvare styrer instrumentoperasjoner, behandler bilder og genererer baseberegninger. Denne serien sørger for dataanalyse på instrumentet og dataoverføringsverktøy for ekstern analyse.
  - ▶ **On-instrument analysis** (Analyse på instrumentet) – Local Run Manager legger inn prøveinformasjon og analyserer deretter kjøningsdata med analysemodulen som er spesifisert for kjøringen. Programvaren inkluderer en serie av analysemoduler.
  - ▶ **Cloud-based analysis** (Skybasert analyse) – Arbeidsflyten for sekvensering er integrert med BaseSpace Sequence Hub, Illumina-skyberegningstiljøet for kjøringsovervåking, dataanalyse, lagring og samarbeid. Utdatafiler strømmes i sanntid til BaseSpace Sequence Hub for analyse.

## Prøve til analyse

Følgende diagram illustrerer hele arbeidsflyten for sekvensering fra eksperimentell utforming til analyse av data. Hvert trinn omfatter verktøy og dokumentasjon. Denne veiledningen dekker trinnet for å sekvensere biblioteker. Du finner annen dokumentasjon på [support.illumina.com](http://support.illumina.com).



**Figur 1** Arbeidsprosess for prøve til analyse



## Tilleggsressurser


Støttesidene til [iSeq 100-sekvenseringssystem](#) på Illuminas nettsted har tilleggsressurser for systemet. Disse ressursene inkluderer programvare, opplæring, kompatible produkter og følgende dokumentasjon. Sjekk alltid støttesider for de nyeste versjonene.

| Ressurs   | Beskrivelse   |
|---|---|
| <a href="#">Tilpasset protokollvelger</a>   | Et verktøy for å generere ende-til-ende-instruksjoner skreddersydd til din metode for bibliotekklargjøring, kjøringparametere og analysemetode, med muligheter for å finjustere detaljnivået. |
| <a href="#">Oppsettplakat for iSeq 100-sekvenseringssystem (dokumentnr. 1000000035963)</a>                        | Gir instruksjoner for installasjon av instrument og førstegangsoppsett.   |
| <a href="#">Veiledning for klargjøring av stedet for iSeq 100-sekvenseringssystem (dokumentnr. 1000000035337)</a> | Gir spesifikasjoner for laboratorieplass, elektriske krav og miljømessige og nettverksmessige hensyn.   |
| <a href="#">Sikkerhets- og samsvarsveiledning for iSeq 100-sekvenseringssystem (dokumentnr. 1000000035336)</a>    | Gir informasjon om operative sikkerhetshensyn, samsvarserklæringer og instrumentdokumentasjon.  |
| <a href="#">Samsvarsveiledning for RFID-leser (dokumentnr. 1000000002699)</a>                                     | Gir informasjon om RFID-leseren i instrumentet, inkludert samsvarsertifiseringer og sikkerhetshensyn.   |

## Instrumentkomponenter

iSeq 100-sekvenseringssystemet omfatter en av/på-knapp, monitor, statuslinje, et forbruksmateriellkammer og et dryppbrett.

Figur 2 Eksterne systemkomponenter

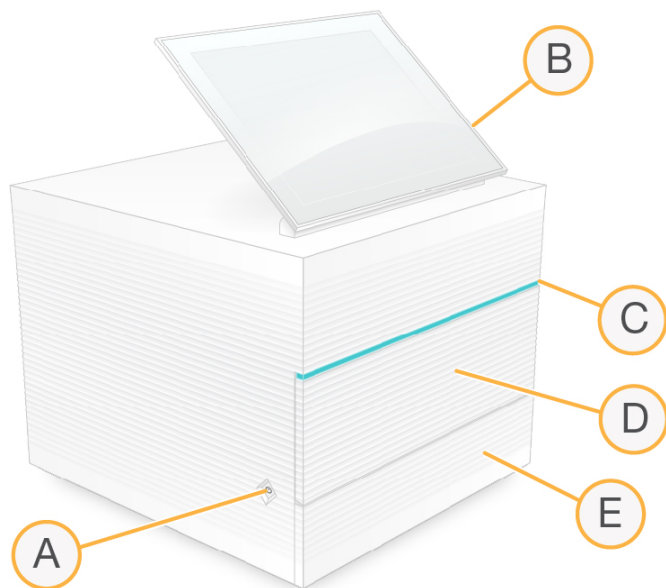

- A **Av/på-knapp** – Styrer strømmen til instrumentet og angir om systemet er på (lyser), av (mørk) eller av, men med vekselstrøm (pulserer).
- B **Berøringsskjermmonitor** – Gjør konfigurasjon og oppsett mulig på instrumentet ved hjelp av kontrollprogramvarens grensesnitt.
- C **Statuslinje** – Angir systemstatus som klar til å sekvensere (grønn), behandler (blå) eller krever oppmerksomhet (oransje).
- D **Forbruksmateriellkammer** – Inneholder forbruksmateriell under en kjøring.
- E **Dryppbrettdør** – Gir tilgang til dryppbrettet, som fanger opp lekkede væsker.

## Strøm- og hjelpetilkoblinger

Du kan flytte instrumentet for å få tilgang til USB-porter og andre komponenter på baksiden.


Bak på instrumentet er det en bryter og et inntak som styrer strøm til instrumentet, samt en Ethernet-port for en valgfri Ethernet-tilkobling. To USB-porter gjør det mulig å koble til en mus eller et tastatur, eller å laste opp og laste ned data med en bærbar enhet.



### MERK

Hvis du kobler systemet til et tastatur og en mus, overstyres tastaturet på skjermen.

Figur 3 Komponenter på baksiden

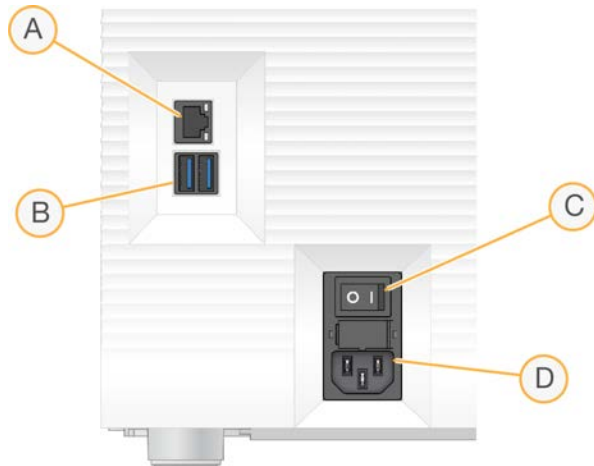


- A **Ethernet-port** – Valgfri tilkobling av Ethernet-kabel.
- B **USB-porter** – To porter for tilkobling av hjelpekomponenter.
- C **Vekslebryter** – Slår strømmen til instrumentet på og av.
- D **Vekselstrøminntak** – Tilkobling av strømledning.

## Forbruksmateriellkammer

Forbruksmateriellkammeret inneholder kassetten for en sekvenseringskjøring.

Figur 4 Lastet forbruksmateriellkammer

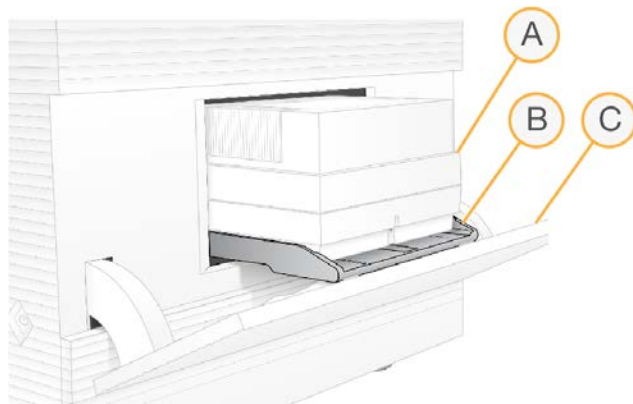

- A **Kassett** – Inneholder strømningcellen, biblioteket og reagensene, og samler opp brukte reagenser under kjøringen.
- B **Brett** – Rommer kassetten under sekvensering.
- C **Dør** – Åpner seg i 60-graders vinkel slik at du får tilgang til forbruksmateriellkammeret.

Programvaren åpner og lukker kammerdøren, og posisjonerer kassetten for avbildning. Døren åpnes ned fra hengsler mot instrumentets sokkel. Ikke sett gjenstander på den åpne døren, da den ikke er laget for å fungere som en hylle.

## Teststrømningscelle og kassett til flergangsbruk

Instrumentet leveres med iSeq 100-teststrømningscellen til flergangsbruk og iSeq 100-testkassetten til flergangsbruk, som skal brukes til systemkontroller.

- ▶ Oppbevares i originalemballasjen ved romtemperatur.
- ▶ Kan brukes på nytt opptil 36 ganger eller i 5 år etter produksjonsdatoen, alt etter hva som nås først.
  - ▶ Under en systemkontroll viser programvaren resterende antall bruk.
  - ▶ Erstatt utløpte testkomponenter til flergangsbruk med testsettet for iSeq 100.

Figur 5 Testkomponenter til flergangsbruk



- A Teststrømningscelle til flergangsbruk
- B Testkassett til flergangsbruk

Testkomponentene til flergangsbruk ligner på sekvenseringskomponentene i iSeq 100 i1-reagens, og innlastingsretningene er de samme. Testkassetten har imidlertid ikke en bibliotekbeholder, og ingen av testkomponentene har kjemien som kreves for en kjøring.

## Systemprogramvare

Systemprogramvareserien innbefatter integrerte programmer som utfører sekvenseringskjøringer og analyse på instrumentet.

- ▶ **iSeq-kontrollprogramvare** – Styrer instrumentoperasjoner og gir et grensesnitt for konfigurering av systemet, oppsett av en sekvenseringskjøring og overvåking av kjøringsstatistikk etter hvert som sekvensering går fremover.
- ▶ **Local Run Manager** – Definerer kjøringsparametere og analysemetoden før sekvensering. Etter sekvensering begynner dataanalyse på instrumentet automatisk.
  - ▶ Systemet leveres med DNA Amplicon, RNA Amplicon og Generate FASTQ samt analysemoduler installert.
  - ▶ Systemet støtter også analysemodulene for anriking og sekvensering av DNA på nytt, som er tilgjengelige på [støttesidene for Local Run Manager](#).
  - ▶ Du finner mer informasjon om Local Run Manager og analysemodulene i *Veiledning for Local Run Manager-programvare* (dokumentnr. 100000002702).
- ▶ **Sanntidsanalyse (RTA2)** – Utfører bildeanalyse og basebetegnelse under kjøringen. Du finner mer informasjon under *Utdata for sekvensering på side 41*.
- ▶ **Universal Copy Service** – Kopierer utdatafiler for sekvensering fra kjøringsmappen til BaseSpace Sequence Hub (hvis det er aktuelt) og utdatamappen, hvor du kan oppnå tilgang til dem.

Sanntidsanalyse og Universal Copy Service kjører kun bakgrunnsprosesser. Local Run Manager og kontrollprogramvaren kan ha behov for brukerinn-data.

## Systeminformasjon

Kontrollprogramvaremenyen har en del som heter About (Om), hvor du kan vise Illumina-kontaktinformasjon og følgende systeminformasjon:

- ▶ Serienummer
- ▶ Datamaskinens navn og IP-adresse
- ▶ Oppskriftsfragmentversjon
- ▶ Kjøringsantall


## Meldinger og varsler

Et ikon vises ved siden av instrumentnavnet for å angi meldinger. Hvis du vil vise en liste over meldingene, som omfatter advarsler og feil, velger du ikonet.

- ▶ Advarsler krever oppmerksomhet, men verken stopper en kjøring eller krever annen handling enn kvittering.
- ▶ Feil krever handling før du kan starte eller fortsette med en kjøring.

Et panel på venstre side av skjermbildene for kjøringssoppsett viser varsler som gjelder spesielt for kassetinnlasting og kontroller før kjøring.

Figur 6 Plasseringer i skjermbildet

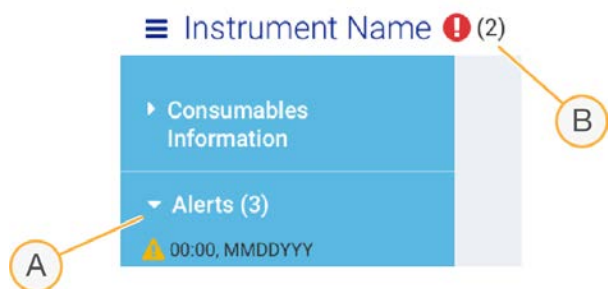

- A Varsler for kjøringssoppsett
- B Andre meldinger

## Prosessbehandling

Skjermbildet Process Management (Prosessbehandling) viser ledig plass (stasjon D) på harddisken og kjøringssstatus, og identifiserer hver kjøring med navn, ID og dato. Skjermbildet oppdateres automatisk hvert tredje minutt.

Kolonnen Status angir om en kjøring pågår eller er fullført basert på behandlingen av BCL-filer. For hver kjøring viser Process Management (Prosessbehandling) dessuten statusen for bakgrunnsprosessene Universal Copy Service, BaseSpace Sequence Hub og Local Run Manager.

Uaktuelle prosesser vises ikke på skjermen. Hvis for eksempel en kjøring ikke er koblet til BaseSpace Sequence Hub, viser ikke Process Management (Prosessbehandling) BaseSpace-statusen for denne kjøringen.

- ▶ Du finner informasjon om hvordan du feilsøker statusproblemer under *Status for prosessbehandling* på side 47.
- ▶ Du finner informasjon om hvordan du sletter kjøring og frigjør plass under *Frigjøre plass på harddisken* på side 33.

## Status for Universal Copy Service

Universal Copy Service viser statusen for filer som blir kopiert fra utdatamappen:

- ▶ **In Progress** (Pågå) – Universal Copy Service kopierer filer til utdatamappen.
- ▶ **Complete** (Fullført) – Universal Copy Service har kopiert alle filene til utdatamappen.

## Status for BaseSpace Sequence Hub

BaseSpace Sequence Hub viser opplastingsstatusen:

- ▶ **In Progress** (Pågå) – Kontrollprogramvaren laster opp filer til BaseSpace Sequence Hub.
- ▶ **Complete** (Fullført) – Alle filene er lastet opp til BaseSpace Sequence Hub.

## Status for Local Run Manager

Local Run Manager viser analysestatusen i kontrollprogramvare:

- ▶ **Not Started** (Ikke startet) – Analysen står i kø for å starte, eller Local Run Manager venter på at sanntidsanalyse skal fullføres.
- ▶ **In Progress** (Pågå) – Local Run Manager analyserer filer. Du finner en mer detaljert status i Local Run Manager-programvaren.
- ▶ **Stopped** (Stoppet) – Analysen har stoppet, men er ikke fullført.
- ▶ **Complete** (Fullført) – Local Run Manager har fullført analysen.

Du finner mer informasjon om analysestatus i Local Run Manager-programvaren.

## iSeq 100 i1-reagens

Å utføre en kjøring på iSeq 100-systemet krever ett iSeq 100 i1-reagenssett til engangsbruk. Settet er tilgjengelig i én størrelse (300 sykluser) og to samlinger:

- ▶ **Enkel** – Inneholder forbruksmateriell til én kjøring.
- ▶ **Firepakning** – Inneholder forbruksmateriell til fire kjøring.

## Innhold og oppbevaring

iSeq 100 i1-reagenssettet inneholder kassetten og strømningscellen for sekvensering. Når du mottar settet:

- ▶ Ikke åpne den hvite folieemballasjen før du blir bedt om det under prosedyrene for tining av kassetten og klargjøring av strømningscellen. Kassetten skal tines i posen.
- ▶ Komponentene må straks settes til oppbevaring ved angitt temperatur for å sikre riktig ytelse.
- ▶ Oppbevar kassetter slik at etikettene på emballasjen vender oppover.
- ▶ Oppbevar kassetter i minst én dag før du tiner dem i et vannbad.

Tabell 1 Settkomponenter


| Samling     | Forbruksmateriell | Antall | Oppbevaringstemperatur |
|-------------|-------------------|--------|------------------------|
| Enkel       | Kassett           | 1      | -25 °C til -15 °C      |
|             | Strømningscelle   | 1      | 2 °C til 8 °C*         |
| Firepakning | Kassett           | 4      | -25 °C til -15 °C      |
|             | Strømningscelle   | 4      | 2 °C til 8 °C*         |

\*Sendes ved romtemperatur.

Begge forbruksmaterielle har identifikatorer som gjør sporing mulig og sikrer kompatibilitet. Kassetten bruker radiofrekvensidentifikasjon (RFID). Strømningscellen bruker et elektrisk grensesnitt: elektrisk slettbart, programmerbart skrivebeskyttet minne (EEPROM).

## Strømningscelle

iSeq 100 i1-strømningscellen er en mønstret strømningscelle med én bane som er bygget over en optisk sensor av typen komplementær metalloksidhalvleder (CMOS). En plastkassett omgir den glassbaserte strømningscellen. Opphevede gripepunkter på plasten sikrer trygg håndtering.

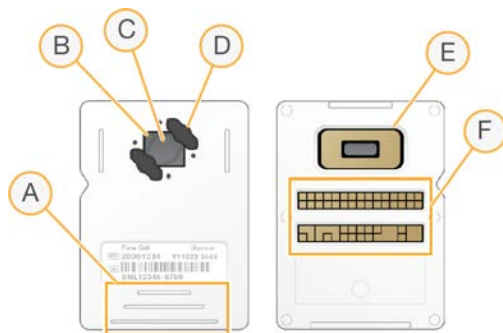


- A Gripepunkter
- B CMOS- sensor (oppå)
- C Avbildningsområde
- D Pakning (én av to)
- E CMOS-sensor (under)
- F Elektrisk grensesnitt

Millioner av nanobrønner dekker overflaten av strømningscellen. Klynger genereres i nanobrønnene. Derfra utføres deretter sekvenseringsreaksjonen. Nanobrønnenes ordnede fordeling øker utdataavlesninger og data. Under sekvensering tar CMOS-sensoren bilder for analyse.

## Kassett

iSeq 100 i1-kassetten er forhåndsfylt med klynge-, sekvenserings-, paired-end- og indekseringsreagenser. En folieforseglet beholder er forbeholdt biblioteker, og et spor på forsiden er forbeholdt strømningscellen. Illuminatorlys når strømningscellen gjennom et tilgangsvindu oppå kassetten.

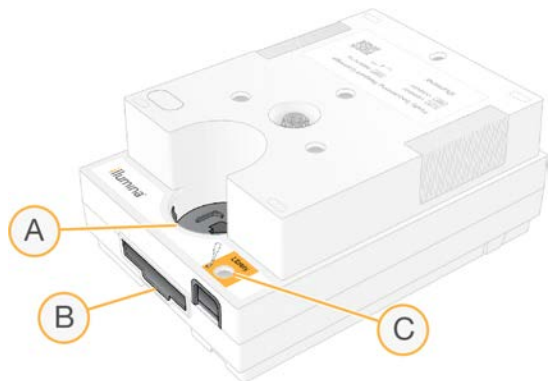

- A Tilgangsvindu
- B Strømningscellespor
- C Bibliotekbeholder

Kassetten rommer alt forbruksmaterieell for en kjøring: reagenser, bibliotek og strømningscelle. Biblioteket og strømningscellen lastes inn i den tinte kassetten, som deretter lastes på instrumentet. Etter at kjøringen har begynt, overføres reagenser og bibliotek automatisk fra kassetten til strømningscellen.

En beholder på undersiden samler opp brukte reagenser. Kassetten inneholder også pumper, ventiler og alle andre væsker for systemet. Fordi kassetten avhendes etter en kjøring, er det ikke nødvendig å vaske instrumentet.



## Antall sykluser som støttes

Etiketten for 300 sykluser på kassetten angir hvor mange sykluser som analyseres, ikke hvor mange sykluser som utføres. Strømningscellen er kompatibel med hvilket som helst antall sykluser og hvilken som helst avlesningstype.








Kassetten sørger for tilstrekkelig reagens for opptil 322 sekvenseringssykluser. De 322 syklusene inkluderer 151 sykluser hver for Read 1 (Avlesning 1) og Read 2 (Avlesning 2), pluss opptil 10 sykluser hver for Index 1 (Indeks 1) og Index 2 (Indeks 2). Du finner informasjon om hvor mange sykluser som skal sekvenseres under *Anbefalt antall sykluser på side 21*.

## Symbolbeskrivelser

Følgende tabell beskriver symbolene på forbruksmateriellet eller forbruksmateriellets emballasje.

| Symbol  | Beskrivelse  |
|---|--|
|  | Dato da forbruksmateriellet utløper. De beste resultatene oppnås ved å bruke forbruksmateriellet for denne datoen. |
|  | Angir produsenten (Illumina).  |



| Symbol  | Beskrivelse   |
|---|---|
|    | Datoen da forbruksmateriellet ble fremstilt.  |
|    | Tiltenkt bruk er Kun til forskningsbruk (RUO).  |
|    | Angir delenummeret slik at forbruksmateriellet kan identifiseres.*  |
|    | Angir partikoden for å identifisere partiet eller loten som forbruksmateriellet ble fremstilt i.*             |
|   | Angir at du må være forsiktig.  |
|  | Angir en helsefare.   |
|  | Temperaturområde for oppbevaring i grader celsius. Oppbevar forbruksmateriellet innenfor det angitte området. |

\* REF identifiserer den enkeltstående komponenten, mens LOT identifiserer loten eller partiet komponenten tilhører.

# Kapittel 2 Komme i gang

|  |    |
|--|----|
| Førstegangs oppsett .....                      | 11 |
| Minimere kontrollprogramvaren .....            | 11 |
| Kjøringsinnstillinger .....                    | 12 |
| Instrumenttilpasning .....                     | 14 |
| Nettverksoppsett .....                         | 16 |
| Brukerlevert forbruksmateriell og utstyr ..... | 17 |

## Førstegangs oppsett

Den første gangen systemet slås på, starter kontrollprogramvaren med en serie skjermbilder som leder deg gjennom førstegangs oppsett. Førstegangs oppsett omfatter å utføre en systemkontroll for å bekrefte instrumentytelse og konfigurere systeminnstillinger.

Hvis du vil endre systeminnstillinger etter førstegangs oppsett, velger du kommandoen System Settings (Systeminnstillinger) i kontrollprogramvaren. Kommandoen åpner fanene Settings (Innstillinger), Network Access (Nettverkstilgang) og Customization (Tilpasning), der du kan oppnå tilgang til alle kontrollprogramvareinnstillinger og Windows-innstillinger for nettverk.

## Operativsystemkonti

Windows-operativsystemet har to konti: administrator (sbsadmin) og bruker (sbsbruker).

Administrator-kontoen skal brukes til IT, systemoppdateringer og installering av kontrollprogramvare, Local Run Manager-analysemoduler og annen programvare. Utfør alle andre funksjoner, deriblant sekvensering, fra brukerkontoen.

## Passordkrav

Operativsystemet krever at passordet endres for begge kontoer (sbsadmin og sbsbruker) ved første pålogging. Oppdater hvert passord hver 180. dag, når du blir bedt om det.

Tabell 2 Standard passordpolicyer

| Policy                                       | Innstilling                  |
|--|------------------------------|
| Tving passordhistorikk                       | Husker fem passord           |
| Terskel for låsing                           | Ti ugyldige påloggingsforsøk |
| Minimum passordlengde                        | Ti tegn                      |
| Passord må oppfylle kravene til kompleksitet | Deaktivert                   |
| Lagre passord med reversibel kryptering      | Deaktivert                   |

## Valideringskjøringer

Du kan eventuelt utføre en valideringskjøring før du sekvenserer eksperimentelle biblioteker for første gang. En valideringskjøring sekvenserer 100 % PhiX, som fungerer som et kontrollbibliotek, for å bekrefte systemdriften. Du finner instruksjoner under [Sekvensering på side 20](#).

## Minimere kontrollprogramvaren

Oppnå tilgang til andre programmer ved å minimere kontrollprogramvaren. Du kan for eksempel bla til utdatamappen i Filutforsker, eller finne et prøveark.

- 1 Åpne Windows-oppgavelinjen ved å sveipe oppover på berøringsskjermen.

- 2 Velg ikonet **iSeq 100 System** (iSeq 100-system) eller et annet program. Kontrollprogramvaren minimeres.
- 3 **[Valgfritt]** Navigering og skrijving utenfor kontrollprogramvaren blir enklere hvis du kobler et tastatur og en mus til instrumentet.
- 4 Sveip og velg **iSeq 100 System** (iSeq 100-system) når du vil maksimere kontrollprogramvaren.

## Kjøringsinnstillinger

Konfigurer alternativer for kjøringssoppsett, kjøringsovervåking og dataanalyse i fanen Settings (Innstillinger) i System Settings (Systeminnstillinger). Denne fanen viser anbefalte hurtiginstillinger som du kan bruke ved å velge alternativet for hurtigoppsett. Alternativt tilpasser du innstillingene ved å velge alternativet for manuelt oppsett.

Hvis du velger hurtiginstillinger, brukes følgende innstillinger, og InterOp-filer, loggfiler, instrumentytelsesdata og kjøringssdata sendes til BaseSpace Sequence Hub:

- ▶ **Illumina Proactive Support** (Illumina proaktiv støtte) – Forenkler feilsøking og påviser potensielle feil, slik at proaktivt vedlikehold kan utføres og instrumentets driftstid maksimeres. Hvis Illumina proaktiv støtte slås på, sendes instrumentytelsesdata (ikke sekvenseringsdata) til BaseSpace Sequence Hub. Du finner mer informasjon i *Illumina proaktiv teknisk merknad* (dokumentnr. 1000000052503).
- ▶ **Local Run Manager** – Bruk Local Run Manager-programvaren til å opprette kjøring og analyser kjøringssdata for en enkel, strømlinjeformet arbeidsflyt. Det er ikke nødvendig med egne prøvemark og analyseprogrammer.
- ▶ **Remote Run Monitoring** (Fjernkjøringsovervåking) – Bruk BaseSpace Sequence Hub til fjernkjøringsovervåking.
- ▶ **Run Analysis, Collaboration, and Storage** (Kjøringsanalyse, samarbeid og lagring) – Bruk BaseSpace Sequence Hub til å lagre og analysere kjøringssdata og samarbeide med kolleger.



### MERK

Local Run Manager starter automatisk analyse når kjøringen er fullført. Du kan imidlertid også analysere data i BaseSpace Sequence Hub.

## Bruke hurtiginstillinger

Hurtigoppsett erstatter de aktuelle kjøringssinnstillingene med anbefalte kjøringssinnstillinger og lokaliserte innstillinger for BaseSpace Sequence Hub. Disse innstillingene krever en Internett-tilkobling og en BaseSpace Sequence Hub-konto. Instruksjoner for kontooppsett finnes i *Elektronisk hjelp for BaseSpace Sequence Hub* (dokumentnr. 1000000009008).

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 I fanen Settings (Innstillinger) velger du **Use Express Settings** (Bruk hurtiginstillinger).
- 3 I listen Set Region (Angi region) velger du den geografiske plasseringen der systemet befinner seg eller stedet nærmest der systemet befinner seg.  
Denne innstillingen sikrer at dataene lagres på riktig plassering for BaseSpace Sequence Hub.
- 4 Hvis du har et Enterprise-abonnement, legger du inn domenenavnet (URL-adressen) i feltet Enter Private Domain (Legg inn privat domene), som brukes til enkeltlogging i BaseSpace Sequence Hub.  
For eksempel: <https://yourlab.basespace.illumina.com>.
- 5 Velg **Next** (Neste).

- 6 Gå gjennom innstillingene. Slik endrer du en innstilling:
  - a Åpne innstillingen ved å velge **Edit** (Rediger).
  - b Endre innstillingen etter behov, og velg deretter **Next** (Neste).
  - c Fortsett gjennom eventuelle påfølgende skjermbilder ved å velge **Next** (Neste).

I skjermbildet Settings Review (Innstillingsgjennomgang) angir en grønn hake aktiverte innstillinger.

- 7 Velg **Save** (Lagre).
- 8 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Konfigurere innstillinger manuelt

Manuelt oppsett leder deg gjennom hvert skjermbilde i fanen Settings (Innstillinger), slik at du kan konfigurere kjøringsinnstillinger som har følgende krav:

- ▶ Å slå på Illumina proaktiv støtte og BaseSpace Sequence Hub krever en Internett-tilkobling. BaseSpace Sequence Hub krever dessuten en konto. Instruksjoner for kontooppsett finnes i *Elektronisk hjelp for BaseSpace Sequence Hub (dokumentnr. 100000009008)*.
- ▶ Å bruke BaseSpace Sequence Hub til dataanalyse når systemet er konfigurert for manuell modus, krever et prøveark. Du finner nærmere detaljer under *Krav til prøveark på side 14*.

1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).

2 Velg **Set Up Manually** (Konfigurer manuelt).

3 Velg om du vil aktivere tjenesten Illumina proaktiv støtte:

- ▶ Slå den på ved å velge avmerkingsboksen **Turn on Illumina Proactive Support** (Slå på Illumina proaktiv støtte).
- ▶ Slå den av ved å velge bort avmerkingsboksen **Turn on Illumina Proactive Support** (Slå på Illumina proaktiv støtte).

Tjenesten sender instrumentytelsesdata, som temperatur og kjøringstid, til Illumina. Disse dataene hjelper Illumina med å påvise potensielle feil og forenkler feilsøking. Kjøringsdata sendes ikke. Du finner mer informasjon i *Illumina proaktiv teknisk merknad (dokumentnr. 1000000052503)*.

4 Velg **Next** (Neste).

5 Velg om kjøring skal kobles til BaseSpace Sequence Hub:

- ▶ Kjøring kobles til ved å velge én av følgende avmerkingsbokser:
  - ▶ **Turn on run monitoring from anywhere only** (Slå kun på overvåking fra hvor som helst) – Bruk BaseSpace Sequence Hub til fjernovervåking.
  - ▶ **Turn on run analysis, collaboration, and storage also** (Slå også på kjøringsanalyse, samarbeid og lagring) – Bruk BaseSpace Sequence Hub til fjernovervåking og analyse.
- ▶ Koble fra kjøring ved å velge bort avmerkingsboksene **Turn on run monitoring from anywhere only** (Slå kun på overvåking fra hvor som helst) og **Turn on run analysis, collaboration, and storage also** (Slå også på kjøringsanalyse, samarbeid og lagring).

Ved tilkobling sender kontrollprogramvaren InterOp- og loggfiler til BaseSpace Sequence Hub.

Alternativet kjøringsanalyse, samarbeid og lagring sender også kjøringsdata.

6 I listen Set Region (Angi region) velger du den geografiske plasseringen der systemet befinner seg eller stedet nærmest der systemet befinner seg.

Denne innstillingen sikrer at dataene lagres på riktig plassering for BaseSpace Sequence Hub.

- 7 Hvis du har et Enterprise-abonnement, legger du inn domenenavnet (URL-adressen) i feltet Enter Private Domain (Legg inn privat domene), som brukes til enkeltpålogging i BaseSpace Sequence Hub. For eksempel: <https://yourlab.basespace.illumina.com>.
- 8 Velg **Next** (Neste).
- 9 Velg om kontrollprogramvaren skal integreres med Local Run Manager:
  - ▶ Hvis du vil opprette kjøring og analysere data i Local Run Manager, velger du **Use Local Run Manager** (Bruk Local Run Manager).
  - ▶ Hvis du vil opprette kjøring i kontrollprogramvaren og analysere data i et annet program, velger du **Use Manual Mode** (Bruk manuell modus).Local Run Manager gir den mest strømlinjeformede arbeidsflyten, men er ikke en funksjon i kontrollprogramvaren. Den er integrert programvare som brukes til å registrere prøver for sekvensering, opprette kjøring og analysere data. Før sekvensering går du gjennom *Veiledning for Local Run Manager-programvare (dokumentnr. 1000000002702)*.
- 10 Velg **Next** (Neste).
- 11 Gå gjennom innstillingene. Slik endrer du en innstilling:
  - a Åpne innstillingen ved å velge **Edit** (Rediger).
  - b Endre innstillingen etter behov, og velg deretter **Next** (Neste).
  - c Fortsett gjennom eventuelle påfølgende skjermbilder ved å velge **Next** (Neste).I skjermbildet Settings Review (Innstillingsgjennomgang) angir en grønn hake aktiverte innstillinger.
- 12 Velg **Save** (Lagre).
- 13 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Krav til prøveark

Når systemet er konfigurert for manuell modus og du analyserer data i BaseSpace Sequence Hub, krever hver kjøring et prøveark. Opprett et prøveark ved å redigere *iSeq 100-systemprøvearkmal for manuell modus* og deretter importere det inn i kontrollprogramvaren under kjøringssoppsett. Etter import gir programvaren automatisk prøvearket det nye navnet **SampleSheet.csv**.

Last ned prøvearkmalen fra støttesidene for iSeq 100-sekvenseringssystemet: [iSeq 100-systemprøvearkmal for manuell modus](#).



### FORSIKTIG

Legg inn adaptersekvensene for Index 2 (Indeks 2) (i5) i riktig retning for iSeq 100-sekvenseringssystemet. Du finner informasjon om indeksretninger i *Illumina-adaptersekvenser (dokumentnr. 1000000002694)*.

Det kreves også et prøveark når systemet er konfigurert for Local Run Manager-modus. Local Run Manager oppretter imidlertid prøvearket for deg og lagrer det til riktig plassering. Under alle andre forhold er et prøveark valgfritt.

## Instrumenttilpasning

Navngi instrumentet ditt, og konfigurere innstillinger for lyd, miniatyrbilder og programvareoppdateringer under fanen Customization (Tilpasning) i System Settings (Systeminnstillinger).

## Navngi instrumentet

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).

- 2 Velg fanen Customization (Tilpasning).
- 3 I feltet Instrument Nickname (Instrumentets kallenavn) oppgir du et foretrukket navn for instrumentet. Navnet vises øverst i hvert skjermbilde.
- 4 Velg **Save** (Lagre).
- 5 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Slå lyd på eller av

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Velg fanen Customization (Tilpasning).
- 3 Velg om systemets lyd skal dempes:
  - ▶ Slå lyden av ved å velge **Off** (Av).
  - ▶ Slå lyden på ved å velge **On** (På).
- 4 Velg **Save** (Lagre).
- 5 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Lagre miniatyrbilder

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Velg fanen Customization (Tilpasning).
- 3 Velg hvordan du vil lagre miniatyrbilder:
  - ▶ Hvis du vil lagre alle miniatyrbilder, velger du avmerkingsboksen **Save all thumbnail images** (Lagre alle miniatyrbilder).
  - ▶ Hvis du ikke vil lagre noen miniatyrbilder, velger du bort avmerkingsboksen **Save all thumbnail images** (Lagre alle miniatyrbilder).

Å lagre miniatyrbilder hjelper under feilsøking, men øker kjøringstørrelsen en anelse. Alle miniatyrbilder lagres som standard.
- 4 Velg **Save** (Lagre).
- 5 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Konfigurere programvareoppdateringer

Systemet kan se etter og laste ned programvareoppdateringer automatisk som du kan installere, eller du kan se etter dem manuelt. Du finner mer informasjon under [Programvareoppdateringer på side 33](#).

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Velg fanen Customization (Tilpasning).
- 3 Velg om systemet skal se etter programvareoppdateringer automatisk:
  - ▶ Vil du se automatisk, velger du avmerkingsboksen **Autocheck for software updates** (Se etter programvareoppdateringer automatisk).
  - ▶ Vil du se manuelt, velger du bort avmerkingsboksen **Autocheck for software updates** (Se etter programvareoppdateringer automatisk).

Det kreves en Internett-forbindelse for å se etter oppdateringer automatisk.
- 4 Velg **Save** (Lagre).
- 5 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Nettverksoppsett

Bruk av systemet og overføring av data krever kun en WiFi- eller Ethernet-tilkobling med standardinnstillingene for nettverk. Det er ikke nødvendig å oppdatere disse innstillingene med mindre organisasjonen har egendefinerte nettverkskrav. Hvis den har det, ber du IT-representanten om hjelp til å endre standardinnstillingene for nettverk.

*Veiledning for klargjøring av stedet for iSeq 100-sekvenseringssystem (dokumentnr. 1000000035337)* inneholder retningslinjer for nettverksinnstillinger og kontrolldatamaskinsikkerhet.

## Angi utdatamappens plassering

Universal Copy Service kopierer utdatafiler for sekvensering fra kjøringsskriptet til BaseSpace Sequence Hub (når det er aktuelt) og utdatamappen, hvor du kan oppnå tilgang til dem.

En utdatamappe kreves med mindre systemet er konfigurert for kjøringsovervåking, kjøringanalyse, samarbeid og lagring med BaseSpace Sequence Hub. Hvis ikke en utdatamappe er angitt, kopierer Universal Copy Service filer til **D:\SequencingRuns**.

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Velg fanen Network Access (Nettverkstilgang).
- 3 I feltet Output Folder (Utdatamappe) legger du inn en standardplassering for utdatamappen eller velger **Browse** (Bla gjennom) hvis du vil navigere til en plassering.
  - ▶ **Internal drive** (Intern stasjon) – Legg inn en eksisterende plassering på stasjon D. Stasjon C mangler tilstrekkelig plass.
  - ▶ **External drive** (Ekstern stasjon) – Legg inn plasseringen til en USB-stasjon som er koblet til instrumentet.
  - ▶ **Network location** (Nettverksplassering) – Legg inn en nettverksplassering.Du kan endre standardplasseringen for hver kjøring.
- 4 Gå frem på følgende måte.
  - ▶ Hvis du har angitt en intern eller ekstern stasjonsplassering, lagrer du plasseringen og lukker System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Save** (Lagre) og deretter **Exit** (Avslutt).
  - ▶ Hvis du anga en nettverksplassering, fortsetter du med trinn 5–8 slik at Universal Copy Service kobles til en konto som har tilgang til den angitte plasseringen.
- 5 Under Universal Copy Service velger du en kontotype:
  - ▶ **Local System Account** (Lokal systemkonto) – Utdatamappen befinner seg i en katalog som det kan oppnås tilgang til med en lokal konto som har tilgang til de fleste lokale plasseringer.
  - ▶ **Network Account** (Nettverkskonto) – Utdatamappen befinner seg i en katalog som krever påloggingsinformasjon.Denne innstillingen gjelder for standardplasseringen for utdatamappen og en eventuell plassering som er angitt under kjøringsoppsett.
- 6 Hvis du valgte Network Account (nettverkskonto), legger du inn brukernavn og passord for kontoen.
- 7 Velg **Save** (Lagre).
- 8 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Koble til Internett

Konfigurer en Internett-tilkobling for Wi-Fi eller Ethernet i Windows' innstillinger for nettverk og Internett, som du kan åpne fra kontrollprogramvaren. Standard Ethernet-tilkobling overfører data på en mer pålitelig måte.

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Settings** (Systeminnstillinger).
- 2 Velg fanen Network Access (Nettverkstilgang).
- 3 Velg **Network Configuration** (Nettverkskonfigurasjon), som minimerer kontrollprogramvaren og åpner Windows' innstillinger for nettverk og Internett.
- 4 Konfigurer en WiFi- eller Ethernet-tilkobling.
  - ▶ Hvis du skal konfigurere WiFi, endrer du adapteralternativet til **Wi-Fi**.
  - ▶ Du finner detaljerte konfigurasjonsinstruksjoner i hjelp for Windows 10 på Microsofts nettsted.
- 5 Når konfigurasjonen er fullført, lukker du innstillingene for Windows og maksimerer kontrollprogramvaren.
- 6 I fanen Network Access (Nettverkstilgang) velger du **Save** (Lagre).
- 7 Lukk System Settings (Systeminnstillinger) ved å velge **Exit** (Avslutt).

## Koble til en proxy-server

- 1 Minimer kontrollprogramvaren.
- 2 I Windows Start åpner du dialogboksen Run (Kjøring).
- 3 Skriv inn **cmd** (Kommando), og deretter velger du **OK**.
- 4 Skriv inn følgende kommando:
 

```
C:\windows\System32\bitsadmin.exe /Util /SetIEProxy LocalSystem Manual_proxy http://<proxyserver>:<proxy port> NULL
```
- 5 Erstatt `http://<proxyserver>:<proxy port>` med din egen proxy-serveradresse og proxy-port, og `NULL` med eventuelle omgørelser.
- 6 Kjør kommandoen ved å trykke på Enter.
- 7 Foreta en strømtilstandsending for instrumentet. Du finner instruksjoner i *Foreta en strømtilstandsending for instrumentet* på side 48.

## Brukerlevert forbruksmateriell og utstyr

Følgende brukerlevert forbruksmateriell og utstyr brukes til sekvensering, vedlikehold og feilsøking.

### Forbruksmateriell for sekvensering

| Forbruksmateriell          | Leverandør   | Formål   |
|----------------------------|--|--|
| Engangshansker, pudderfrie | Generell laboratorieleverandør   | Generelt formål.                                     |
| iSeq 100 i1-reagens        | Illumina, katalognr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20021533 (enkel)</li> <li>• 20021534 (firepakning)</li> </ul> | Leverer reagenser og strømningcellen til en kjøring. |
| Mikrorør, 1,5 ml           | Fisher Scientific, katalognr. 14-222-158, eller tilsvarende rør med lav binding  | Fortynne biblioteker til lastekonsentrasjonen.       |



| Forbruksmaterieill                        | Leverandør                                      | Formål  |
|---|---|---|
| Tørkepapir                                | Generell laboratorieleverandør                  | Tørke kassetten etter et vannbad.                                       |
| Dråpetellerspisser, 20 µl                 | Generell laboratorieleverandør                  | Fortynne og laste biblioteker.  |
| Dråpetellerspisser, 100 µl                | Generell laboratorieleverandør                  | Fortynne og laste biblioteker.  |
| Resuspensjonsbuffer (RSB)                 | Illumina, leveres med bibliotekklargjøringssett | Fortynne biblioteker til lastekonsentrasjonen.                          |
| <b>[Valgfritt]</b> 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 | Generell laboratorieleverandør                  | Erstatning for RSB for å fortynne biblioteker til lastekonsentrasjonen. |
| <b>[Valgfritt]</b> PhiX Control v3        | Illumina, katalognr. FC-110-3001                | Utføre en kjøring kun med PhiX eller tilsetning i en PhiX-kontroll.     |

## Forbruksmaterieill for vedlikehold og feilsøking

| Forbruksmaterieill                             | Leverandør   | Formål   |
|--|--|--|
| Blekemiddelservietter, 10 %                    | WWR, katalognr. 16200-218, eller tilsvarende                           | Dekontaminere instrumentet og rengjøre arbeidsflater.  |
| Engangshansker, puddefrie                      | Generell laboratorieleverandør   | Generelt formål.   |
| iSeq 100 i1 ekstra dryppbrettpute <sup>1</sup> | Illumina, katalognr. 20023927  | Dekke dryppbrettet for å absorbere væskelekkasjer.   |
| Ekstra luftfilter for iSeq 100 i1 <sup>1</sup> | Illumina, katalognr. 20023928  | Bytte luftfilter hver sjette måned.  |
| Testsett for iSeq 100-system <sup>2</sup>      | Illumina, katalognr. 20024141  | Utføre en systemkontroll.  |
| Servietter med isopropylalkohol, 70 %          | WWR, katalognr. 95041-714, eller tilsvarende                           | Rengjøre instrumentet og teststrømningscelle til flergangsbruk.  |
| Laboratorieklut, lavt loinnhold                | WWR, katalognr. 21905-026, eller tilsvarende                           | Tøking av dryppbrettet og teststrømningscelle til flergangsbruk.   |
| Tørkepapir                                     | Generell laboratorieleverandør   | Tørke opp væske rundt instrumentet.  |
| <b>[Valgfritt]</b> Kloropløsning, 10 %         | WWR, katalognr 16003-740 (32 oz), 16003-742 (16 oz), eller tilsvarende | Rengjøre arbeidsflater etter dekontaminering.  |
| <b>[Valgfritt]</b> Etanolservietter, 70 %      | Fisher Scientific, katalognr. 19-037-876, eller tilsvarende            | Erstatning for servietter med isopropylalkohol for å rengjøre instrumentet og teststrømningscelle til flergangsbruk. |

<sup>1</sup> Instrumentet leveres med én installert og én ekstra. Hvis instrumentet ikke er underlagt garanti, har brukeren ansvaret for utskiftninger.

Oppbevares innpakket frem til bruk.

<sup>2</sup> Erstatte testkomponenter til flergangsbruk levert sammen med instrumentet ved utløp etter 5 år eller 36 gangers bruk.

## Utstyr

| Vare                      | Kilde                          | Formål   |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Fryser, -25 °C til -15 °C | Generell laboratorieleverandør | Oppbevare kassetten.                           |
| Isbøtte                   | Generell laboratorieleverandør | Sette til side biblioteker.                    |
| Dråpeteller, 10 µl        | Generell laboratorieleverandør | Fortynne biblioteker til lastekonsentrasjonen. |
| Dråpeteller, 20 µl        | Generell laboratorieleverandør | Fortynne biblioteker til lastekonsentrasjonen. |

| Vare                        | Kilde                          | Formål   |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Dråpeteller, 100 µl         | Generell laboratorieleverandør | Fortynne biblioteker til lastekonsentrasjonen. |
| Kjøleskap, 2 °C til 8 °C    | Generell laboratorieleverandør | Oppbevare strømningscellen.                    |
| <b>[Valgfritt]</b> Tastatur | Generell laboratorieleverandør | Tillegg til skjermtastaturet.                  |
| <b>[Valgfri]</b> Mus        | Generell laboratorieleverandør | Tillegg til berøringsskjermgrensesnittet.      |
| <b>[Valgfritt]</b> Vannbad  | Generell laboratorieleverandør | Tine kassetten.                                |

# Kapittel 3 Sekvensering

|   |    |
|---|----|
| Innledning .....  | 20 |
| Tine kassetten i pose .....                                   | 21 |
| Klargjøre strømningscellen og bibliotekene .....              | 22 |
| Laste forbruksmaterieill inn i kassetten .....                | 24 |
| Konfigurere en sekvenseringskjøring (Local Run Manager) ..... | 26 |
| Konfigurere en sekvenseringskjøring (manuell modus) .....     | 29 |

## Innledning

Klyngegenerering, sekvensering og analyse omfatter sekvensering på iSeq 100-sekvenseringssystemet. Hvert trinn skjer automatisk under en sekvenseringskjøring. Avhengig av systemkonfigurasjonen utføres ytterligere analyse utenfor instrumentet etter at kjøringen er fullført.

- ▶ **Klyngegenerering** – Bibliotek denatureres automatisk til enkle strenger, og fortynnes ytterligere i instrumentet. Under klyngegenereringen blir enkle DNA-molekyler bundet til overflaten på strømningscellen og forsterket for å danne klynger.
- ▶ **Sekvensering** – Klynger avbildes ved hjelp av kjemi med ett fargestoff, som bruker én fluorescerende etikett og to avbildningssykluser når data skal kodes for de fire nukleotidene. Den første avbildningssyklusen påviser adenin (A) og tymin (T). En kjemisyklus spalter deretter fargestoffet fra A, og tilsetter samtidig et lignende fargestoff i cytosin (C). Den andre avbildningen påviser C og T. Etter den andre avbildningen utfører sanntidsanalyseprogramvare basebetegnelse, filtrering og kvalitetsscoreing. Denne prosessen gjentas for hver sekvenseringssyklus. Du finner mer informasjon om kjemi med ett fargestoff under *Basebetegnelse på side 44*.
- ▶ **Analyse** – Mens kjøringen går fremover, overfører kontrollprogramvaren automatisk basebetegnelsesfiler (\*.bcl) til den angitte utdataplasseringen for dataanalyse. Fremgangsmåten for dataanalyse avhenger av programmet og systemkonfigurasjonen.

## Lastevolum og -konsentrasjon

Lastevolum er 20 µl. Lastekonsentrasjonen varierer etter bibliotektype.

| Bibliotektype                      | Innlastingskonsentrasjon (pM) |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 100 % PhiX                         | 60                            |
| AmpliSeq Library PLUS for Illumina | 50                            |
| Nextera DNA Flex                   | 200                           |
| Nextera Flex for Enrichment        | 100                           |
| TruSeq DNA Nano                    | 100                           |
| TruSeq DNA PCR-Free                | 100                           |

For andre bibliotektyper anbefaler Illumina 50 pM som en startlastekonsentrasjon. Optimaliser denne konsentrasjonen i løpet av påfølgende kjøring slik at en lastekonsentrasjon som konsekvent gir data som oppfyller spesifikasjonene, identifiseres.

Lastekonsentrasjoner som er for høye eller for lave, fører til suboptimal klynge- og kjøringmetrikk. Du finner mer informasjon i *Veiledning for klyngeoptimalisering (dokumentnr. 1000000071511)*.

## Anbefalt antall sykluser

Hvis du legger inn minimum 26 sykluser og maksimalt 151 sykluser for hver avlesning, bidrar det til å sikre datakvaliteten. Det nøyaktige antallet sykluser avhenger av forsøket du utfører.

Minimum og maksimalt antall sykluser inkluderer en ekstra syklus. Legg alltid én syklus til den ønskede avlesningslengden slik at virkningene av fasing og prefasing korrigeres. Avlesningslengde er antall **sekvenseringscykluser** i Read 1 (Avlesning 1) og Read 2 (Avlesning 2), som ekskluderer ekstra sykluser og indekssykluser.

Eksempel på kjøringsoppsett:

- ▶ Hvis du ønsker en avlesningslengde på 36 (enkel avlesning), oppgir du **37** i feltet Read 1 (Avlesning 1).
- ▶ Hvis du ønsker en avlesningslengde på 150 per avlesning (paired-end), oppgir du **151** i feltet Read 1 (Avlesning 1) og **151** i feltet Read 2 (Avlesning 2).

## Beste praksis

- ▶ Når du håndterer reagenser og andre kjemikalier, må du ha på deg sikkerhetsbriller, en labfrakk og pulverfrie hansker. Skift hansker når du blir bedt om det, slik at du unngår krysskontaminasjon.
- ▶ Kontroller at du har det nødvendige forbruksmateriellet og utstyret før du starter en protokoll. Se *Brukerlevert forbruksmaterieell og utstyr på side 17*.
- ▶ Følg protokollene i den viste rekkefølgen, og bruk de angitte volumene, temperaturene og varighetene.
- ▶ Hvis ikke et stoppunkt er angitt, går du straks videre til neste trinn.

## Tine kassetten i pose

- 1 Hvis du skal tine kassetten i et vannbad, oppbevarer du kassetten ved  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$  i minst én dag før tining. Et vannbad er den raskeste av tre tinemetoder, som beskrives i trinn 5.



### FORSIKTIG

Hvis du tiner en kassett i et vannbad rett etter levering når den er oppbevart på tørris, kan det ha negativ innvirkning på kassetts ytelse.

- 2 Ta på et nytt par pudderfrie hansker.
- 3 Ta kassetten ut av oppbevaring ved  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- 4 Hvis kassetten ligger i en eske, fjerner du den fra esken, men **ikke åpne den hvite folieposen**.



- 5 Tin kassetten i pose ved hjelp av én av følgende fremgangsmåter. Brukes umiddelbart etter tining. Skal ikke fryses på nytt eller oppbevares på andre måter.

| Fremgangsmåte                       | Tinetid                         | Instruksjon   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 20 °C til 25 °C vannbad             | 6 timer, ikke mer enn 18 timer  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk 6 l vann per kassett.</li> <li>• Still et temperaturstyrt bad på 25 °C, <b>eller</b> bland varmt og kaldt vann for å oppnå 20 °C til 25 °C.</li> <li>• Vend poseetiketten opp, senk kassetten helt ned i vann, og påfør en vekt på ~2 kg for å hindre at den flyter opp.</li> <li>• Ikke stable kassetter i vannbad med mindre det er temperaturstyrt.</li> </ul> |
| Kjøleskap fra 2 °C til 8 °C         | 36 timer, ikke mer enn 72 timer | Plasser kassetten slik at etiketten vender opp og luft kan sirkulere på alle sider, inkludert under den.  |
| Romtemperert luft (20 °C til 25 °C) | 9 timer, ikke mer enn 18 timer  | Plasser kassetten slik at etiketten vender opp og luft kan sirkulere på alle sider, inkludert under den.  |

6 Hvis den er våt etter et vannbad, tørkes den med tørkepapir.

## Klargjøre strømningscellen og bibliotekene

Før du laster strømningscellen og bibliotekene i kassetten, sørger du for at strømningscellen når romtemperatur, fortynner biblioteker og eventuelt anriker med PhiX. Biblioteker denatureres automatisk i instrumentet.

Følgende fortynningsinstruksjoner gjelder for støttede Illumina-biblioteker som er dobbeltstrengede. Følgende må alltid gjøres: utfør en kvalitetskontrollanalyse, optimaliser lastekonsentrasjonen for biblioteket ditt, og bruk en normaliseringsmetode som genererer dobbeltstrengede biblioteker. Kulebasert normalisering som genererer enkeltstrengede biblioteker, er ikke kompatibel med denaturering i instrumentet.

## Fortynne bibliotek til 1 nM

1 Klargjør strømningscellen på følgende måte.

- a Fjern en ny strømningscelle fra oppbevaring ved 2 °C til 8 °C.
- b Sett den uåpnede emballasjen til side ved romtemperatur i 10–15 minutter for å forhindre kondensering.

Hvis du klargjør strømningscellen nå, vil den oppnå romtemperatur i tide.

- 2 Ta resuspensjonsbuffer (RSB) ut av oppbevaring ved –25 °C til –15 °C. Du kan alternativet bruke 10 mM Tris-HCl, pH 8,5 i stedet for RSB.
- 3 **[Valgfritt]** Ta 10 nM PhiX-råstoff ut av oppbevaring ved –25 °C til –15 °C. PhiX er kun nødvendig for en valgfri anriking eller en kjøring kun med PhiX.
- 4 Tin RSB og eventuelt PhiX ved romtemperatur i 10 minutter.
- 5 Bruk RSB som fortynner, og klargjør det aktuelle bibliotekvolumet på 1 nM i et mikrorør *med lav binding*:

| Bibliotektype                            | Bibliotekvolum på 1 nM som skal klargjøres (µl) |
|--|---|
| 100 % PhiX (for en kjøring kun med PhiX) | 8   |
| AmpliSeq Library PLUS for Illumina       | 7   |
| Nextera DNA Flex                         | 25  |
| Nextera Flex for Enrichment              | 12  |
| TruSeq DNA Nano                          | 12  |
| TruSeq DNA PCR-Free                      | 12  |

Å fortynne biblioteker i mikrorør med lav binding er avgjørende for vellykket sekvensering.

- 6 Roter et kort øyeblikk, og deretter sentrifugerer du ved 280 × g i 1 minutt.
- 7 **[Valgfritt]** Oppbevar 1 nM bibliotek ved –25 °C til –15 °C i opptil 1 måned.

## Fortynne bibliotek på 1 nM til innlastingskonsentrasjon

- 1 Kombiner følgende volumer i et mikrorør med lav binding for å klargjøre 100 µl bibliotek fortynnet med den riktige innlastingskonsentrasjonen:

| Bibliotektype*                     | Innlastingskonsentrasjon (pM) | 1 nM bibliotekvolum (µl) | RSB-volum (µl) |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 100 % PhiX                         | 60                            | 6                        | 94             |
| AmpliSeq Library PLUS for Illumina | 50                            | 5                        | 95             |
| Nextera DNA Flex                   | 200                           | 20                       | 80             |
| Nextera Flex for Enrichment        | 100                           | 10                       | 90             |
| TruSeq DNA Nano                    | 100                           | 10                       | 90             |
| TruSeq DNA PCR-Free                | 100                           | 10                       | 90             |

\* Når det gjelder bibliotektyper som ikke er oppgitt, inkludert andre Nextera-biblioteker, begynner du med en lastekonsentrasjon på 50 pM og optimerer i løpet av påfølgende kjøring.

Denne tabellen gir eksempler på lastekonsentrasjoner. iSeq 100-systemet er kompatibelt med alle bibliotekklargjøringssett fra Illumina, unntatt SureCell WTA 3', men den optimale lastekonsentrasjonen kan variere.

- 2 Roter et kort øyeblikk, og deretter sentrifugerer du ved 280 × g i 1 minutt.
- 3 Sett fortynnet bibliotek til side på is for sekvensering.  
Sekvenser biblioteker som er fortynnet til lastekonsentrasjonen samme dag som de fortynnes.
- 4 Hvis du **ikke** skal legge til PhiX, eller hvis du skal utføre en kjøring kun med PhiX, skal du hoppe over neste del og gå videre til *Laste forbruksmaterieell inn i kassetten på side 24*.

## Tilsette en PhiX-kontroll (valgfritt)

PhiX er et lite Illumina-bibliotek som er klart til bruk med balansert nukleotidfremstilling. Tilsetning av en 2 % PhiX-anriking til biblioteket gir ytterligere metrikk. For biblioteker med lav diversitet anbefales 5 % anriking for å øke basediversitet.



### MERK

En anriking så lav som 1 % er effektiv for å gi ytterligere beregninger, men gjør pipettering vanskelig.

- 1 Kombiner følgende volumer i et mikrorør med lav binding for å klargjøre 50 µl 1 nM PhiX:
  - ▶ 10 nM PhiX (5 µl)
  - ▶ RSB (45 µl)
- 2 Roter et kort øyeblikk, og deretter sentrifugerer du ved 280 × g i 1 minutt.
- 3 **[Valgfritt]** Oppbevar 1 nM PhiX ved –25 °C til –15 °C i opptil 1 måned.

- 4 Kombiner følgende volumer i et mikrorør med lav binding for å fortynne PhiX til samme innlastingskonsentrasjon som biblioteket, for eksempel:

| PhiX-innlastingskonsentrasjon (pM) | 1 nM PhiX-volum (µl) | RSB-volum (µl) |
|------------------------------------|----------------------|----------------|
| 50                                 | 5                    | 95             |
| 100                                | 10                   | 90             |
| 200                                | 20                   | 80             |

- 5 Kombiner PhiX og bibliotek:
- ▶ Tilsett 2 µl fortynnet PhiX til 100 µl fortynnet bibliotek for å få en 2 % anriking.
  - ▶ Tilsett 5 µl fortynnet PhiX til 100 µl fortynnet bibliotek for å få en 5% anriking.
- Faktisk PhiX-prosentandel varierer avhengig av bibliotekets kvalitet og kvantitet.
- 6 Roter et kort øyeblikk, og deretter sentrifugerer du ved 280 × g i 1 minutt.
- 7 Sett biblioteket med PhiX-anriking til side på is.

## Laste forbruksmaterieell inn i kassetten


- [Valgfritt]** Hvis du vil se en instruksjon om klargjøring og lasting av kassetter, velger du **Sequence** (Sekvens).
- Åpne kassettposen fra hakkene.
- Unngå tilgangsvinduet øverst på kassetten, og ta kassetten ut av posen. Kast posen.
- Snu kassetten fem ganger for å blande reagensene.  
Innvendige komponenter kan rasle når du snur kassetten, noe som er helt normalt.
- Sikre reagensaspirasjon ved å slå kassetten (med etiketten vendt opp) lett mot benken eller en annen hard overflate fem ganger.

## Laste inn bibliotek

- Perforer bibliotekbeholderen med en ny dråpetellerspiss, og skyv folien ut til kantene slik at hullet forstørres.



- Kast dråpetellerspissen slik at kontaminasjon unngås.
- Tilsett 20 µl fortynnet bibliotek i **bunnen** av beholderen. Unngå å ta på folien.

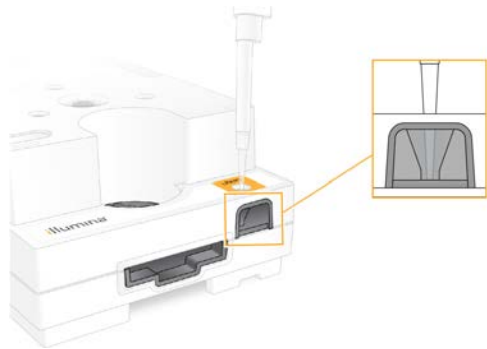


## Laste inn strømningcellen

- 1 Åpne den hvite folieemballasjen fra hakkene. Må brukes innen 24 timer etter åpning.
- 2 Dra strømningcellen ut av emballasjen.  
Du må kun berøre plasten ved håndtering av strømningcellen. Unngå å berøre det elektriske grensesnittet, CMOS-sensoren, glass og pakninger på begge sider av glasset.



- 3 Hold strømningcellen i gripepunktene med etiketten vendt opp.
- 4 Plasser strømningcellen i sporet på forsiden av kassetten.  
Det høres et klikk som angir at strømningcellen er på plass. Når kassetten er lastet riktig inn, stikker grepet frem fra kassetten, og glasset er synlig fra tilgangsvinduet.

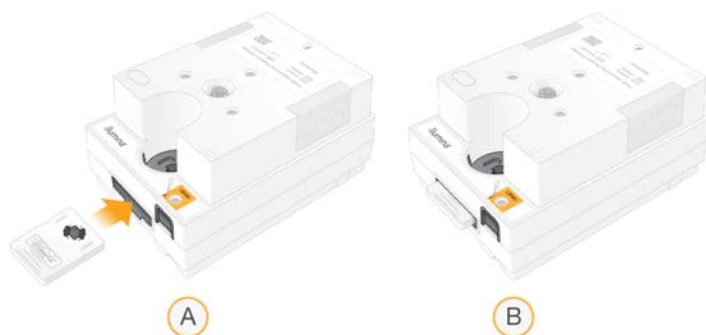

- A Innlasting av strømningcellen  
B Innlastet strømningcelle



- 5 Avhend emballasjen på følgende måte.
  - a Fjern oppbevaringskofferten fra folieemballasjen.
  - b Fjern tørkemiddelet fra oppbevaringskofferten.
  - c Resirkuler oppbevaringskofferten, og kast folieemballasjen og tørkemiddelet.
- 6 Gå frem avhengig av om systemet er integrert med Local Run Manager:
  - ▶ Hvis du bruker Local Run Manager, følger du *Konfigurere en sekvenseringskjøring (Local Run Manager)* på side 26.
  - ▶ Hvis du ikke bruker Local Run Manager, følger du *Konfigurere en sekvenseringskjøring (manuell modus)* på side 29.

## Konfigurere en sekvenseringskjøring (Local Run Manager)

Å sette opp en kjøring med Local Run Manager innebærer å opprette og lagre kjøringen i Local Run Manager for deretter å gå tilbake til kontrollprogramvaren og laste forbruksmaterieell samt velge kjøringen. Data lagres til den angitte utdatamappen for analyse, som Local Run Manager utfører automatisk når kjøringen er fullført.

- 1 Åpne Local Run Manager lokalt på instrumentets monitor eller eksternt fra en annen datamaskin:

| Tilgang | Åpne Local Run Manager   |
|---------|--|
| Lokal   | I kontrollprogramvaremenyen velger du <b>Local Run Manager</b> , og deretter velger du <b>Open Local Run Manager</b> (Åpne Local Run Manager).   |
| Ekstern | I kontrollprogramvaremenyen velger du <b>About</b> (Om) slik at du får tilgang til systemets IP-adresse. Fra en datamaskin i samme nettverk som instrumentet åpner du Local Run Manager i Chromium. Koble til ved hjelp av systemets IP-adresse. |

- 2 Hvis Chromium er tom på instrumentets monitor, foretar du en strømtilstandsending for instrumentet og starter kjøringssoppsettet på nytt. Du finner instruksjoner i *Foreta en strømtilstandsending for instrumentet* på side 48.
- 3 Opprett og lagre kjøringen i Local Run Manager.
  - ▶ Du finner instruksjoner i *Veiledning for Local Run Manager-programvare (dokumentnr. 1000000002702)*.
  - ▶ Konfigurer en kjøring kun med PhiX som ikke skal indekseres. Local Run Manager sender automatisk lagrede kjøring til kontrollprogramvaren.
- 4 Velg **Sequence** (Sekvens) i programvaren. Programvaren åpner døren på skrått, støter ut brettet og starter serien med skjermbildet for kjøringssoppsett.
- 5 **[Valgfritt]** Vis en påminnelse i skjermbildet ved å velge **Help** (Hjelp). Hjelpemeldinger vises i hvert skjermbilde for å gi tilleggsveiledning.

## Laste kassetten inn i instrumentet

- 1 Kontroller at kassetten er tint og inneholder strømningscellen og det fortynnede biblioteket.

- 2 Plasser testkassetten på brettet slik at tilgangsvinduet vender opp og strømningcellen er inne i instrumentet. Ikke skyv kassetten eller brettet inn i instrumentet.



- 3 Trekk inn kassetten og lukk døren ved å velge **Close Door** (Lukk dør).  
Et panel vises i venstre side av skjermbildet, som viser informasjon fra det skannede forbruksmateriellet.

## Logge på BaseSpace Sequence Hub

Skjermbildet BaseSpace Sequence Hub vises når systemet er konfigurert for Run Monitoring (Kjøringsovervåking) eller Run Monitoring and Storage (Kjøringsovervåking og -lagring).

- 1 Hvis du vil koble den aktuelle kjøringen fra BaseSpace Sequence Hub, velger du **Skip BaseSpace Sequence Hub Sign In** (Hopp over pålogging på BaseSpace Sequence Hub).  
Instrumentytelsesdata sendes likevel til Illumina.
- 2 Hvis du vil endre tilkobling for den aktuelle kjøringen, velger du et konfigurasjonsalternativ:
  - ▶ **Run Monitoring Only** (Kun kjøringsovervåking) – Send kun InterOp-filer til BaseSpace Sequence Hub for å tillate fjernovervåking.
  - ▶ **Run Monitoring and Storage** (Kjøringsovervåking og -lagring) – Send kjøringsdata til BaseSpace Sequence Hub for å tillate fjernovervåking og analyse.
- 3 Legg inn påloggingsinformasjonen din for BaseSpace Sequence Hub (e-postadresse og passord), og deretter velger du **Sign In** (Logg på).
- 4 Hvis listen Available Workgroups (Tilgjengelige arbeidsgrupper) vises, velger du en arbeidsgruppe som du vil laste opp kjøringsdata til.  
Listen vises når du tilhører flere arbeidsgrupper.
- 5 Velg **Run Setup** (Kjør oppsett).

## Velge en kjøring

- 1 Hvis påloggingsskjermbildet for Local Run Manager vises, oppgir du brukernavn og passord, og deretter velger du **Log In** (Logg på).  
Skjermbildet vises når Local Run Manager er konfigurert for å kreve pålogging. Pålogging er som standard ikke påkrevd.
- 2 Velg en kjøring i listen Run Name (Kjøringsnavn), som oppgir kjøring som er lagret i Local Run Manager.
  - ▶ Vis en oppdatert liste ved å velge **Refresh** (Oppdater).
  - ▶ Hvis listen er tom, oppretter du en kjøring ved å velge **Open Local Run Manager** (Åpne Local Run Manager).Hvis du velger Open Local Run Manager (Åpne Local Run Manager), minimeres kontrollprogramvaren, og Local Run Manager åpnes i Chromium.

- 3 Hvis du forlot kontrollprogramvaren for å opprette en kjøring, går du tilbake og velger kjøringen. Vis en oppdatert liste ved å klikke på **Refresh** (Oppdater).
- 4 **[Valgfritt]** Velg **Edit** (Rediger), og endre kjøringens parametere:
  - a Hvis du vil endre avlesningstype, velger du **Single Read** (Enkel avlesning) eller **Paired End** (Paired-end).
  - b Hvis du vil endre Read Cycle (Avlesningssyklus), legger du inn **26–151** sykluser hver for Read 1 (Avlesning 1) og Read 2 (Avlesning 2). Legg én syklus til ønsket antall sykluser.
  - c Hvis du vil endre utdatamappen for den aktuelle kjøringen, legger du inn banen til plasseringen eller velger **Browse** (Bla gjennom) og navigerer til den.
  - d Velg **Save** (Lagre), så oppdateres kjøringen i både kontrollprogramvaren og Local Run Manager.
- 5 Start kontrollen før kjøring ved å velge **Start Run** (Start kjøring).

## Gå gjennom kontroller før kjøring

Kontroller før kjøring innbefatter en instrumentkontroll og en strømningskontroll. Strømningskontrollen perforerer kassettforseglingene og sender reagens gjennom strømningscellen, slik at forbruksmaterieell ikke kan brukes på nytt etter at strømningskontrollen starter.

- 1 Vent i ca. 15 minutter mens kontrollene før kjøring fullføres. Kjøringen starter automatisk etter fullføring. Med mindre systemets lyd er dempet, angir en ringelyd at kjøringen har startet.



### FORSIKTIG

Hvis du åpner døren under kontrollen før kjøring eller kjøringen, kan kjøringen mislykkes.

- 2 Hvis det oppstår en feil under instrumentkontrollen, velger du **Retry** (Prøv på nytt) slik at kontrollen utføres på nytt. Instrumentkontrollen kommer før strømningskontrollen. Når en kontroll pågår, er stolpen for denne kontrollen aktiv.
- 3 Hvis en feil oppstår på nytt, feilsøker du i henhold til *Løse feilmeldinger på side 47*.

## Overvåke kjøringens fremdrift

- 1 Overvåk kjøringens fremdrift og metrikk etter hvert som de vises i skjermbildet Sequencing (Sekvensering) etter syklus 26.

| Metrikk   | Beskrivelse   |
|---|---|
| %Q30 Read 1 (%Q30 avlesning 1)                    | Prosentandelen av basebetegnelser for Read 1 (Avlesning 1) med en Q-score $\geq 30$ . |
| %Q30 Read 2 (%Q30 avlesning 2)                    | Prosentandelen av basebetegnelser for Read 2 (Avlesning 2) med en Q-score $\geq 30$ . |
| % Clusters PF (% klynge-PF)                       | Prosentandelen av klynger som passerte kvalitetsfiltre.                               |
| %Occupancy (% fyllingsgrad)                       | Prosentandelen av strømningscellebrønner som inneholder klynger.                      |
| Projected Total Yield (Planlagt total produksjon) | Det forventede antallet baser som betegnes for kjøringen.                             |

- 2 Hvis du vil overvåke filkopiering og andre kjøringens prosesser, velger du kontrollprogramvaremenyen, og deretter velger du **Process Management** (Prosessbehandling).

## Laste ut forbruksmateriell

- 1 Når sekvensering er fullført, velger du **Eject Cartridge** (Støt ut kassett). Programvaren støter den brukte kassetten ut av instrumentet.
- 2 Fjern kassetten fra brettet.
- 3 Fjern strømningscellen fra kassetten.
- 4 Avhend strømningscellen, som har elektroniske komponenter, i henhold til gjeldende lokale standarder.
- 5 Avhend kassetten, som inneholder brukte reagenser, i henhold til gjeldende lokale standarder. En kjøring etter vasking er ikke nødvendig fordi væsken avhendes sammen med kassetten.



### ADVARSEL

Dette reagenssettet inneholder potensielt farlige kjemikalier. Personskade kan forekomme ved innånding, svelging, hudkontakt og øyekontakt. Bruk verneutstyr, inkludert vernebriller, hansker og laboratoriefrakk som er egnet ved risiko for eksponering. Brukte reagenser skal behandles som kjemisk avfall og kastes i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om helse, miljø og sikkerhet, kan du se mer på [support.illumina.com/sds.html](https://support.illumina.com/sds.html).

- 6 Last inn brettet på nytt og gå tilbake til startskjermbildet ved å velge **Close Door** (Lukk dør). Programvaren laster automatisk inn brettet på nytt, og sensorer bekrefter at kassetten er fjernet.

## Konfigurere en sekvenseringskjøring (manuell modus)

Å sette opp en kjøring i manuell modus betyr å angi kjøringsparametere i kontrollprogramvaren og utføre analyse utenfor instrumentet med et program etter eget ønske. Programvaren lagrer data til den angitte utdatamappen for analysen. Hvis du vil generere FASTQ-filer, kreves det et ekstra trinn.

- 1 Hvis systemet er konfigurert for kjøringsanalyse, samarbeid og lagring med BaseSpace Sequence Hub, oppretter du et prøveark for kjøringen:
  - a Last ned *iSeq 100-systemprøvearkmal for manuell modus* fra [støttesidene for iSeq 100-sekvenseringssystem](#).
  - b Endre malen etter behov, og lagre den i \*.CSV-format. Kontroller at:
    - ▶ Adaptersekvensene for Index 2 (Indeks 2) (i5) er i riktig retning. Du finner informasjon om retninger i *Illumina-adaptersekvenser (dokumentnr. 100000002694)*.
    - ▶ Prøvearkverdier samsvarer med kontrollprogramvareverdier. Legg for eksempel inn 151 i feltet Read 1 (Avlesning 1) i både prøvearket og skjermbildet Run Setup (Kjøringsoppsett).
- 2 Velg **Sequence** (Sekvens) i programvaren. Programvaren åpner døren på skrått, støter ut brettet og starter serien med skjermbildet for kjøringsoppsett.
- 3 **[Valgfritt]** Vis en påminnelse i skjermbildet ved å velge **Help** (Hjelp). Hjelpemeldinger vises i hvert skjermbilde for å gi tilleggsveiledning.

## Laste kassetten inn i instrumentet

- 1 Kontroller at kassetten er tint og inneholder strømningscellen og det fortynnede biblioteket.

- 2 Plasser testkassetten på brettet slik at tilgangsvinduet vender opp og strømningcellen er inne i instrumentet. Ikke skyv kassetten eller brettet inn i instrumentet.



- 3 Trekk inn kassetten og lukk døren ved å velge **Close Door** (Lukk dør).  
Et panel vises i venstre side av skjermbildet, som viser informasjon fra det skannede forbruksmateriellet.

## Logge på BaseSpace Sequence Hub

Skjermbildet BaseSpace Sequence Hub vises når systemet er konfigurert for Run Monitoring (Kjøringsovervåking) eller Run Monitoring and Storage (Kjøringsovervåking og -lagring).

- 1 Hvis du vil koble den aktuelle kjøringen fra BaseSpace Sequence Hub, velger du **Skip BaseSpace Sequence Hub Sign In** (Hopp over pålogging på BaseSpace Sequence Hub).  
Instrumentytelsesdata sendes likevel til Illumina.
- 2 Hvis du vil endre tilkobling for den aktuelle kjøringen, velger du et konfigurasjonsalternativ:
  - ▶ **Run Monitoring Only** (Kun kjøringsovervåking) – Send kun InterOp-filer til BaseSpace Sequence Hub for å tillate fjernovervåking.
  - ▶ **Run Monitoring and Storage** (Kjøringsovervåking og -lagring) – Send kjøringsdata til BaseSpace Sequence Hub for å tillate fjernovervåking og analyse (krever et prøveark).
- 3 Legg inn påloggingsinformasjonen din for BaseSpace Sequence Hub (e-postadresse og passord), og deretter velger du **Sign In** (Logg på).
- 4 Hvis listen Available Workgroups (Tilgjengelige arbeidsgrupper) vises, velger du en arbeidsgruppe som du vil laste opp kjøringsdata til.  
Listen vises når du tilhører flere arbeidsgrupper.
- 5 Velg **Run Setup** (Kjør oppsett).

## Legge inn kjøringsparametere

- 1 I feltet Run Name (Kjøringsnavn) oppgir du et unikt navn etter ønske som identifiserer den aktuelle kjøringen.  
Kjøringsnavnet kan inneholde alfanumeriske tegn, bindestreker og understrekningstegn.
- 2 For Read Type (Avlesningstype) velger du ett av følgende alternativer:
  - ▶ **Single Read** (Enkel avlesning) – Utfør én sekvenseringsavlesning, som er det raskeste, enkleste alternativet.
  - ▶ **Paired End** (Paired-end) – Utfør to sekvenseringsavlesninger, som genererer data av høyere kvalitet og gir mer nøyaktig innretting.
- 3 I Read Cycle (Avlesningssyklus) oppgir du antall sykluser som skal utføres i hver avlesning.
  - ▶ For Read 1 (Avlesning 1) og Read 2 (Avlesning 2) legger du til én syklus til ønsket antall sykluser.
  - ▶ For en kjøring kun med PhiX legger du inn **0** i begge indeksfeltene.

| Avlesning            | Antall sykluser |
|----------------------|-----------------|
| Read 1 (Avlesning 1) | 26–151          |
| Index 1 (Indeks 1)   | Opptil 10       |
| Index 2 (Indeks 2)   | Opptil 10       |
| Read 2 (Avlesning 2) | 26–151          |

Read 2 (Avlesning 2) er typisk den samme verdien som Read 1 (Avlesning 1), inkludert den ekstra syklusen. Index 1 (Indeks 1) sekvenserer i7-indeksadapteren, og Index 2 (Indeks 2) sekvenserer i5-indeksadapteren.

- Hvis du vil angi en utdatamappe for den aktuelle kjøringen eller laste opp et prøveark, velger du **Advanced** (Avansert):
  - I feltet Output Folder (Utdatamappe) legger du inn banen til utdatamappens plassering eller velger **Browse** (Bla gjennom) og navigerer til den.
  - I feltet Sample Sheet (Prøveark) legger du inn banen til prøvearkets plassering eller velger **Browse** (Bla gjennom) og navigerer til den.
- Start kontrollen før kjøring ved å velge **Start Run** (Start kjøring).

## Gå gjennom kontroller før kjøring

Kontroller før kjøring innbefatter en instrumentkontroll og en strømningskontroll. Strømningskontrollen perforerer kassettforseglingene og sender reagens gjennom strømningscellen, slik at forbruksmaterieell ikke kan brukes på nytt etter at strømningskontrollen starter.

- Vent i ca. 15 minutter mens kontrollene før kjøring fullføres.  
Kjøringen starter automatisk etter fullføring. Med mindre systemets lyd er dempet, angir en ringelyd at kjøringen har startet.



### FORSIKTIG

Hvis du åpner døren under kontrollen før kjøring eller kjøringen, kan kjøringen mislykkes.

- Hvis det oppstår en feil under instrumentkontrollen, velger du **Retry** (Prøv på nytt) slik at kontrollen utføres på nytt.  
Instrumentkontrollen kommer før strømningskontrollen. Når en kontroll pågår, er stolpen for denne kontrollen aktiv.
- Hvis en feil oppstår på nytt, feilsøker du i henhold til [Løse feilmeldinger på side 47](#).

## Overvåke kjøringens fremdrift

- Overvåk kjøringens fremdrift og metrikk etter hvert som de vises i skjermbildet Sequencing (Sekvensering) etter syklus 26.

| Metrikk   | Beskrivelse   |
|---|---|
| %Q30 Read 1 (%Q30 avlesning 1)                    | Prosentandelen av basebetegnelser for Read 1 (Avlesning 1) med en Q-score $\geq 30$ . |
| %Q30 Read 2 (%Q30 avlesning 2)                    | Prosentandelen av basebetegnelser for Read 2 (Avlesning 2) med en Q-score $\geq 30$ . |
| % Clusters PF (% klynge-PF)                       | Prosentandelen av klynger som passerte kvalitetsfiltre.                               |
| %Occupancy (% fyllingsgrad)                       | Prosentandelen av strømningscellebrønner som inneholder klynger.                      |
| Projected Total Yield (Planlagt total produksjon) | Det forventede antallet baser som betegnes for kjøringen.                             |

- 2 Hvis du vil overvåke filkopiering og andre kjøringsprosesser, velger du kontrollprogramvaremenyen, og deretter velger du **Process Management** (Prosessbehandling).

## Laste ut forbruksmateriell

- 1 Når sekvensering er fullført, velger du **Eject Cartridge** (Støt ut kasset). Programvaren støter den brukte kassetten ut av instrumentet.
- 2 Fjern kassetten fra brettet.
- 3 Fjern strømningscellen fra kassetten.
- 4 Avhend strømningscellen, som har elektroniske komponenter, i henhold til gjeldende lokale standarder.
- 5 Avhend kassetten, som inneholder brukte reagenser, i henhold til gjeldende lokale standarder. En kjøring etter vasking er ikke nødvendig fordi væsken avhendes sammen med kassetten.



### ADVARSEL

Dette reagenssettet inneholder potensielt farlige kjemikalier. Personskade kan forekomme ved innånding, svelging, hudkontakt og øyekontakt. Bruk verneutstyr, inkludert vernebriller, hansker og laboratoriefrakk som er egnet ved risiko for eksponering. Brukte reagenser skal behandles som kjemisk avfall og kastes i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om helse, miljø og sikkerhet, kan du se mer på [support.illumina.com/sds.html](https://support.illumina.com/sds.html).

- 6 Last inn brettet på nytt og gå tilbake til startskjermbildet ved å velge **Close Door** (Lukk dør). Programvaren laster automatisk inn brettet på nytt, og sensorer bekrefter at kassetten er fjernet.

# Kapittel 4 Vedlikehold

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Frigjøre plass på harddisken .....    | 33 |
| Programvareoppdateringer .....        | 33 |
| Skifte ut luftfilteret .....          | 35 |
| Flytte instrumentet .....             | 36 |
| Programvarebegrensningspolicyer ..... | 38 |

## Frigjøre plass på harddisken

En sekvenseringskjøring krever ca. 2 GB ledig plass på harddisken. Når det er lite ledig plass, sletter du fullførte kjøring og frigjør plass ved å følge disse trinnene.

- 1 I kontrollprogramvaremenyen velger du **Process Management** (Prosessbehandling).  
Skjermbildet Process Management (Prosessbehandling) vises med en liste over kjøring som er lagret til harddisken.
- 2 Velg **Delete** (Slett) for kjøringen du vil slette.  
Når du sletter en kjøring, slettes den lokale kjøringssmappen. Utdatamappen, som er en kopi av kjøringssmappen, beholdes.
- 3 I dialogboksen bekrefter du sletting av kjøringen ved å velge **Yes** (Ja).
- 4 Gjenta og for hver kjøring du vil slette.
- 5 Når du er ferdig, velger du Process Management (Prosessbehandling) for å gå tilbake til skjermbildet Sequence (Sekvens).

## Programvareoppdateringer

Hvis du oppdaterer programvaren, sikrer du at systemet har de nyeste funksjonene og feilrettingene. Programvareoppdateringer er samlet i en systemserie som inneholder følgende programvare:

- ▶ iSeq kontrollprogramvare
- ▶ iSeq 100-systemoppskrifter
- ▶ Universal Copy Service
- ▶ Sanntidsanalyse
- ▶ Local Run Manager (kun rammeverk)



### MERK

Selv om systemserien inneholder Local Run Manager, inneholder den ikke analysemodulene. Installer dem separat etter behov ved hjelp av sbsadmin-kontoen. Oppnå tilgang til analysemodusprogramvaren fra støttesidene for Local Run Manager.

Systemet er konfigurert for å laste ned programvareoppdateringer automatisk eller manuelt:

- ▶ **Automatic updates** (Automatiske oppdateringer) – Oppdateringer lastes automatisk ned fra BaseSpace Sequence Hub slik at du kan installere dem. Dette alternativet krever Internett-tilkobling, men ikke en BaseSpace Sequence Hub-konto.
- ▶ **Manual updates** (Manuelle oppdateringer) – Oppdateringer lastet ned fra nettet, lagres lokalt eller på en bærbar enhet, og installeres fra den lagrede plasseringen. Dette alternativet krever ikke en Internett-tilkobling.



## Installere en automatisk programvareoppdatering

- 1 Bytt til sbsadmin-operativsystemkontoen.
- 2 Velg kontrollprogramvaremenyen, og velg deretter **Software Update** (Programvareoppdatering) for å åpne dialogboksen Software Update (Programvareoppdatering).  
Systemer som er konfigurert for automatiske oppdateringer viser et varsel når en programvareoppdatering er tilgjengelig.
- 3 Hvis du vil se etter en oppdatering, velger du ett av følgende alternativer:
  - ▶ **Check for Update** (Se etter oppdatering) – Se etter en programvareoppdatering.
  - ▶ **Autocheck for Updates** (Se etter oppdateringer automatisk) – Se etter en programvareoppdatering, og konfigurer systemet slik at det ser etter fremtidige oppdateringer automatisk.Disse alternativene er synlige på systemer som er koblet til Internett, men ikke konfigurert for automatiske oppdateringer.
- 4 Last ned den nye programvareversjonen ved å velge **Update** (Oppdater).  
Når nedlastingen er fullført, lukkes kontrollprogramvaren, og installasjonsveiviseren vises.
- 5 Velg **Install** (Installer) i installasjonsveiviseren.



### MERK

Hvis du avbryter en oppdatering før installasjonen er fullført, stopper oppdateringen på det aktuelle stedet. Eventuelle endringer som er utført frem til avbrytelsen gjenoprettes til den forrige versjonen eller installeres ikke.

- 6 Når installasjonen er fullført, velger du **Close** (Lukk).  
Kontrollprogramvaren starter automatisk på nytt. En eventuell fastvareoppdatering skjer automatisk etter omstarten.

## Installere en manuell programvareoppdatering

- 1 Bytt til sbsadmin-operativsystemkontoen.
- 2 Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, laster du ned installasjonsprogrammet for serien (\*.exe) fra **støttesiden for iSeq 100-sekvenseringssystem**. Lagre installasjonsprogrammet til en lokal eller bærbar stasjon.
- 3 Hvis du lagret installasjonsprogrammet til en bærbar stasjon, plugges du stasjonen i en USB-port på baksiden av instrumentet. Flytt instrumentet etter behov for å få tilgang til baksiden.
- 4 I kontrollprogramvaren velger du **Software Update** (Programvareoppdatering) i kontrollprogramvaremenyen.
- 5 I dialogboksen Software Update (Programvareoppdatering) utvider du **Install from local or portable drive** (Installer fra lokal eller bærbar stasjon).
- 6 Naviger til installasjonsprogrammet ved å velge **Browse** (Bla gjennom).
- 7 Start initialiseringen ved å velge **Update** (Oppdater).  
Kontrollprogramvaren lukkes, og installasjonsveiviseren vises.

- 8 Velg **Install** (Installer) i installasjonsveiviseren.



#### **MERK**

Hvis du avbryter en oppdatering før installasjonen er fullført, stopper oppdateringen på det aktuelle stedet. Eventuelle endringer som er utført frem til avbrytelsen gjenoprettes til den forrige versjonen eller installeres ikke.

- 9 Når installasjonen er fullført, velger du **Close** (Lukk).  
Kontrollprogramvaren starter automatisk på nytt. En eventuell fastvareoppdatering skjer automatisk etter omstarten.

## Skifte ut luftfilteret


Luftfilteret er en skumbit til engangsbruk, som dekker de to viftene på baksiden av instrumentet. Det sørger for grundig avkjøling og forhindrer at smuss kommer inn i systemet. Instrumentet leveres med ett installert luftfilter og ett i reserve. Ekstra reservedeler omfattes av garantien, eller de kan kjøpes fra Illumina.

Programvaren varsler om et bytte av luftfilter hver sjette måned etter at førstegangs oppsett ble startet. Skift ut et utløpt luftfilter ved hjelp av følgende instruksjoner.


- 1 Plasser instrumentet slik at du enkelt får tilgang til baksiden.
- 2 På baksiden av instrumentet trykker du på høyre side av dekkplaten slik at den frigjøres som vist i illustrasjonen nedenfor.




- 3 Fjern platen fra instrumentet.

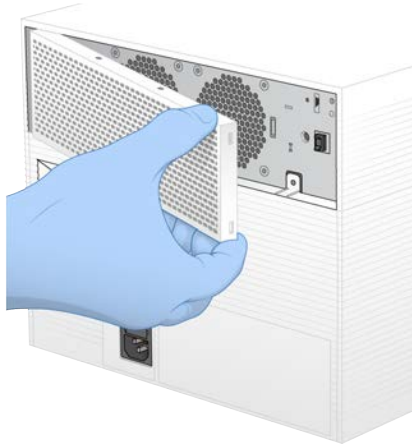

- 4 Fjern skumluftfilteret fra midten av platen, og kast det.

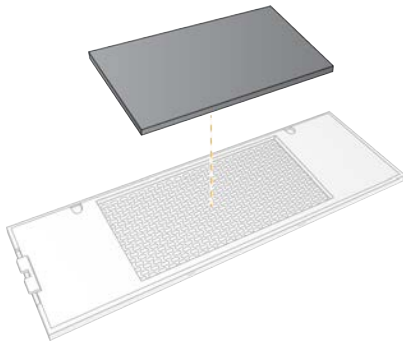

- 5 Plasser et nytt luftfilter i platen, og trykk for å feste.
- 6 Sett de to platekrokene inn i hullene i instrumentet, og trykk platen på plass.

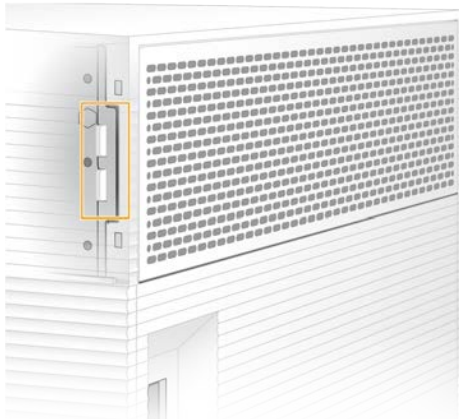

- 7 Sett instrumentet tilbake på plass.
- 8 Fortsett ved å velge **Filter Changed** (Filter byttet).


## Flytte instrumentet

Flytt instrumentet på en sikker måte ved hjelp av følgende instruksjoner. Kontroller at den nye plasseringen oppfyller kravene som beskrives i *Veiledning for klargjøring av stedet for iSeq 100-sekvenseringssystem* (dokumentnr. 100000035337).

Hvis du skal sende et instrument i retur, hopper du over dette avsnittet og går til *Avansert bytte* på side 55.

- 1 Velg **Shut Down System** (Avslutt system) i menyen.
- 2 Hvis ikke systemet avsluttes, trykker du på og holder inne av/på-knappen på venstre side av instrumentet til lyset tones ned.
- 3 Når av/på-knappen pulserer, trykker du på av-siden (**O**) av vekslebryteren på baksiden. Det kan hende at av/på-knappen fortsetter å pulsere etter at strømmen er slått av.

**Figur 7** Veksleknappens plassering

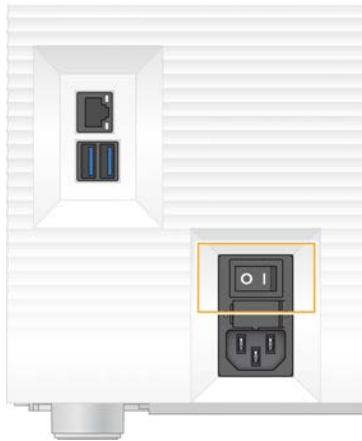

- 4 Koble strømledningen fra stikkkontakten, og deretter fra vekselstrømuttaket på baksiden.
- 5 Hvis det er aktuelt, kobler du Ethernet-kabelen fra stikkkontakten, og deretter fra Ethernet-porten på baksiden.
- 6 Senk monitoren.
- 7 Flytt instrumentet til ønsket plassering.  
Instrumentet veier 15,9 kg, og må løftes av to personer.
- 8 Hev monitoren.
- 9 Hvis instrumentet er koblet til et nettverk, kobler du Ethernet-kabelen til en Ethernet-port.
- 10 Koble strømledningen til strøminntaket på baksiden og deretter til en stikkontakt.
- 11 Trykk på på-siden (I) av vekslebryteren.

12 Når av/på-knappen pulserer, trykker du på den.

**Figur 8** Av/på-knappens plassering



13 Når operativsystemet er lastet, logger du deg på Windows.

Kontrollprogramvaren startes og initialiserer systemet. Startskjermbildet vises når initialiseringen er fullført.

## Programvarebegrensningspolicier

Windows programvarebegrensningspolicier (SRP) bruker regler for kun å tillate at spesifisert programvare kjøres. Når det gjelder iSeq 100-systemet, er SRP-regler basert på sertifikater, filnavn og -typer samt kataloger.

SRP er slått på som standard slik at uønsket programvare hindres i å kjøre på kontrolldatamaskinen. En IT-representant eller systemadministrator kan legge til og fjerne regler slik at sikkerhetsnivået tilpasses. Hvis systemet er lagt til et domene, kan det lokale gruppepolicyobjektet (GPO) automatisk endre reglene og slå av SRP.

## Tillatte SRP-regler

På iSeq 100-sekvenseringssystemet tillater SRP følgende regler som standard.

### Sertifikater

iSeq-programsertifikat

### Kjørbare filer

Portmon.exe

Procmon.exe

Procmon64.exe

Tcpview.exe

### Filtyper

\*.cfg

\*.lnk

\*.png

\*.tif

\*.txt

\*.xml

### Kataloger

%HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProgramFilesDir%  
%HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRoot%  
C:\CrashDumps\  
C:\Illumina Maintenance Logs\  
C:\Illumina Manufacturing Test Results\  
C:\Illumina\  
C:\Program Files (x86)\Chromium\Application\  
C:\Program Files (x86)\Illumina\  
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\  
C:\Program Files\Illumina\  
C:\Program Files\Internet Explorer\  
C:\Program Files\Jenoptik\  
C:\Program Files\Ophir Optronics\  
C:\ProgramData\Illumina\  
C:\ProgramData\Package Cache\  
C:\ProgramData\webex\  
C:\Users\\*\AppData\Local\GoToAssist Corporate\  
C:\Users\\*\AppData\Local\Temp\Citrix\  
C:\Users\\*\AppData\Local\Temp\CitrixLogs\  
C:\Users\\*\AppData\Local\Temp\LogMeIn\  
C:\Users\\*\AppData\Local\Temp\LogMeInLogs\  
D:\Recovery\  
GoToAssist Corporate Opener\*.exe  
Turnover to customer.bat

## Legge til og fjerne SRP- regler

Tilpass systemsikkerheten ved å legge til og fjerne SRP- regler. Du må slå av SRP midlertidig mens du endrer reglene.



### FORSIKTIG

Hvis du slår av SRP, overstyres standardbeskyttelsen.

- 1 Logg deg på operativsystemet med administratorkontoen.  
Administratorkontoen har rettighetene som er nødvendige for å endre SRP-reglene.
- 2 Slå av SRP:
  - a Naviger til katalogen C:\Illumina\Security.
  - b Dobbeltklikk på **Disable.reg**.
  - c Bekreft endringene ved å velge **Yes** (Ja).

Når du bruker berørings skjermgrensesnittet, tilsvarer å trykke og holde i ca. 2 sekunder et høyreklikk.

- 3 Velg **Start**, og deretter velger du **Run** (Kjøring).
- 4 I feltet Open (Åpne) oppgir du **secpol.msc**.
- 5 I dialogboksen Local Security Policy (Lokal sikkerhetspolicy) utvider du **Software Restriction Policies** (Programvarebegrensningspolicyer), og deretter velger du **Additional Rules** (Tilleggsregler).
- 6 Slik legger du til en regel:
  - a I menyen Action (Handling) velger du **New Path Rule** (Ny baneregel).
  - b I feltet Path (Bane) oppgir du sertifikatet, filnavnet, filtypen eller katalogen som du vil tillate.
  - c I listen Security (Sikkerhetsnivå) velger du **Unrestricted** (Ubegrenset).

- d **[Valgfritt]** I feltet Description (Beskrivelse) oppgir du en årsak for å opprette regelen.
  - e Legg til regelen ved å velge **OK**.
- 7 Slik sletter du en regel:
- a Velg regelen du vil slette, og velg deretter **Delete** (Slett).
  - b Bekreft slettingen ved å velge **Yes** (Ja).
- 8 Lukk dialogboksen Local Security Policy (Lokal sikkerhetspolicy).
- 9 Gjeninnsett SRP *umiddelbart*:
- a Naviger til katalogen C:\Illumina\Security.
  - b Dobbeltklikk på **Enable.reg**.
- 10 Hvis SRP- regler ble endret for første gang, logger du av og deretter på igjen for at reglene skal tre i kraft.

# Vedlegg A Utdata for sekvensering

|  |    |
|--|----|
| Oversikt over sanntidsanalyse .....      | 41 |
| Arbeidsprosess for sanntidsanalyse ..... | 43 |

## Oversikt over sanntidsanalyse

Sanntidsanalyseprogramvaren kjører på instrumentets kontrolldatamaskin. Under en sekvenseringskjøring ekstraherer den intensiteter fra bilder slik at den kan utføre basebetegnelse, og deretter tilordnes basebetegnelsen en kvalitetsscore.

iSeq 100-sekvenseringssystem bruker RTA2-implementeringen av sanntidsanalyse. RTA2 og kontrollprogramvaren kommuniserer gjennom et HTTP-grensesnitt på nettet og delte minnefiler. Hvis RTA2 avsluttes, gjenopptas ikke behandlingen, og kjøringsdata lagres ikke.



### MERK

Demultipleksytelse beregnes ikke, så fanen Index (Indeks) i Sequencing Analysis Viewer er ikke fylt ut.

## Inndatafiler

RTA2 krever følgende inndatafiler for behandling:

- ▶ Flisbilder plassert i et lokalt systemminne.
- ▶ Konfigurasjonsfil for **sanntidsanalyse** i XML-format.
- ▶ **RunInfo.xml**, som kontrollprogramvaren genererer automatisk i begynnelsen av kjøringen.

RTA2 mottar kommandoer fra kontrollprogramvaren som inkluderer informasjon om plasseringen til **RunInfo.xml** og om en utdatafil er spesifisert. Fra **RunInfo.xml** avleser RTA2 kjøringsnavnet, antall sykluser, om en avlesning er indeksert og antall fliser på strømningscellen.

## Utdatafiler

Bilder sendes i minne til RTA2 som fliser, som er små avbildningsområder på strømningscellen definert av én kameravinsing. iSeq 100 i1-strømningscellen har 16 fliser.

Fra disse bildene produserer RTA2 et sett med kvalitetsscorede basebetegnelsesfiler og filterfiler som primære utdata. Andre filer støtter generering av de primære utdataene.

| Filtype                    | Filtype, -plassering og -navn   |
|----------------------------|---|
| Basebetegnelsesfiler       | Hver flis som er analysert innbefattes i en basebetegnelsesfil, som aggregeres i én fil per syklus. Den aggregerte filen inneholder basebetegnelsen og tilknyttet kvalitetsscore for hver klynge.<br><b>Data\Intensities\BaseCalls\L001</b><br><b>[Cycle].bcl.bgzf</b> , hvor [Cycle] (Syklus) representerer syklusnummeret i fire sifre.<br>Basebetegnelsesfiler komprimeres ved hjelp av blokk-GZip-komprimering. |
| Basebetegnelsesindeksfiler | En basebetegnelsesindeksfil bevarer den opprinnelige flisinformatjonen. For hver flis inneholder indeksfilen flisnummeret og antallet klynger.<br><b>Data\Intensities\BaseCalls\L001</b><br><b>[Cycle].bcl.bgzf.bci</b>   |
| Klyngeplasseringsfiler     | Én klyngeplasseringsfil (s.locs) inneholder X-, Y-koordinatene for hver klynge på strømningscellen.<br><b>Data\Intensities</b><br><b>s.locs</b>   |



| Filtype                  | Filtype, -plassering og -navn   |
|--------------------------|---|
| Filterfiler              | Filterfiler angir om klynger går gjennom filter. Det genereres én filterfil for hver flis. Filterfiler genereres i syklus 26 med 25 sykluser med data.<br>Data\Intensities\BaseCalls\L001<br>s_[lane].filter                        |
| InterOp-filer            | Sanntidsmetrikk av kjøringens kvalitet som oppdateres gjennom hele kjøringen. Disse binære filene inneholder fil-, syklus- og avlesningsmetrikk, og er nødvendige for å vise metrikk i Sequencing Analysis Viewer.<br>InterOp-mappe |
| RTA-konfigurasjonsfil    | Oppgir parametere for kjøringen. Filen opprettes i begynnelsen av kjøringen og kombinerer verdier fra inndatakonfigurasjonsfilen og verdiene som RTA2 definerer.<br>[Rotmappe], RTAConfiguration.xml                                |
| Kjøringsinformasjonsfil* | Oppgir kjøringens navn, antall sykluser per avlesning, om avlesningen er en indeksavlesning samt antall skår og fliser. Opprettes i begynnelsen av kjøringen.<br>[Rotmappe], RunInfo.xml  |
| Miniatyrbildefiler       | Miniatyrbilder av strømningscellefliser.<br>Images\L001\C[X.1] – Filer lagres i én mappe for hver bane og én undermappe for hver syklus.<br>s_[lane]_[tile].jpg – Miniatyrbildet innbefatter flisnummeret.                          |

\*Opprettet av kontrollprogramvaren. RTA2 oppretter alle andre filer som er oppgitt i tabellen.

Local Run Manager og BaseSpace Sequence Hub konverterer automatisk basebetegnelsesfiler til FASTQ-filer. Ved sekvensering i manuell modus bruker du den nyeste versjonen av bcl2fastq2-konverteringsprogramvaren til å konvertere FASTQ-filer. Last ned programvaren fra [støttesidene for bcl2fastq-konverteringsprogramvare](#) på Illuminas nettsted.

## Utdatamappens navn og bane

For hver kjøring genererer kontrollprogramvaren automatisk en utdatamappe og en kjøringssmappe. Du får tilgang til kjøringssdataene fra utdatamappen, som er en kopi av kjøringssmappen. Kjøringssmappen er beregnet på systembruk.

Banen til utdatamappen er brukerdefinert, men er D:\ som standard. Kontrollprogramvaren navngir utdatamappen med følgende format.

| Format  | Eksempel                           |
|---|------------------------------------|
| <ÅÅÅMMDD>_<Instrument-ID>_<Kjøringsnummer>_<Strømningscelle-ID> | 20180331_FFSP247_4_BNS417-05-25-12 |

Kjøringsnummeret øker i trinn på én hver gang systemet utfører en kjøring. Serienumre identifiserer instrumentet og strømningscellen.

## Utdatamappens struktur

- 📁 **Recipe** (Oppskrift) – Kjøringsspesifikk oppskriftsfil.
- 📁 **Logs** (Logger) – Loggfiler som beskriver instrumentanalyser, driftstrinn og andre hendelser.
- 📁 **Config** (Konfig.) – Konfigurasjonsinnstillinger for kjøringen.
- 📄 RunParameters.xml
- 📄 RunInfo.xml
- 📄 CopyComplete.txt
- 📄 RunCompletionStatus.txt
- 📄 RTAComplete.txt
- 📄 RTAConfiguration.xml
- 📁 **Data**
  - 📁 **Intensities** (Intensiteter)
    - 📁 **BaseCalls** (Basebetegnelser)
      - 📁 **L001**
        - 📄 s.locs
- 📁 **InterOp**
- 📁 **Images** (Bilder)
- 📄 SampleSheet.csv – Prøveark eller prøvemanifestet.
- 📁 **RTALogs** – Loggfiler som beskriver RTA2-hendelser.


## Feilhåndtering

RTA2 oppretter loggfiler og skriver dem til RTALogs-mappen. Feil registreres i en feilfil i TSV-filformat.

Følgende logg- og feilfiler overføres til det endelige utdatamålet etter endt behandling:

- ▶ \*GlobalLog\*.tsv sammenfatter viktige kjøringshendelser.
- ▶ \*Error\*.tsv oppgir feil som oppsto under en kjøring.
- ▶ \*WarningLog\*.tsv oppgir advarsler som oppsto under en kjøring.

## Arbeidsprosess for sanntidsanalyse

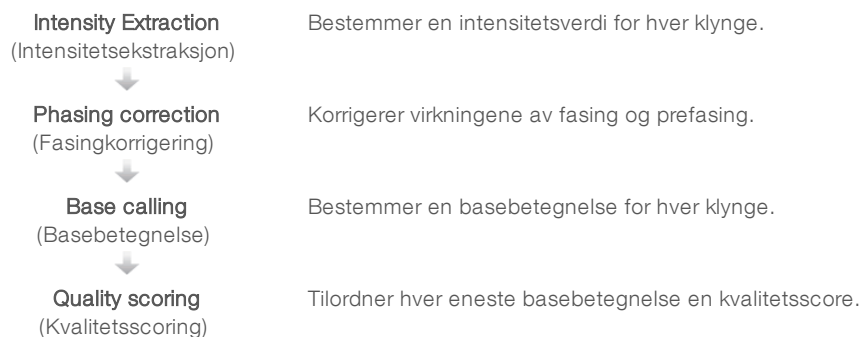

## Intensitetsekstraksjon


Intensitetsekstraksjon beregner en intensitetsverdi for hver nanobrønn i et gitt bilde.

## Fasingkorrigering

Under sekvenseringsreaksjonen utvides hver DNA-tråd i et cluster med én base per syklus. Fasing og prefasing forekommer når en streng havner utenfor fase med den aktuelle inkorporasjonssyklusen.

- ▶ Fasing forekommer når en base havner på etterskudd.
- ▶ Prefasing forekommer når en base hopper fremover.

Figur 9 Fasing og prefasing

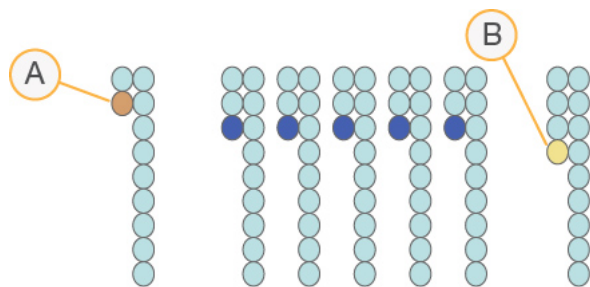

- A Avles med en base som er fasing
- B Avles med en base som er prefasing


RTA2 korrigerer virkningene av fasing og prefasing, noe som maksimerer datakvaliteten i hver syklus gjennom hele kjøringen.

## Basebetegnelse

Basebetegnelse bestemmer en base (A, C, G eller T) for hver klynge for en gitt flis ved en spesifikk syklus. iSeq 100-systemet bruker sekvensering med ett fargestoff, som krever ett fargestoff og to bilder for å kode data for de fire basene.

Intensiteter som ekstraheres fra ett bilde og sammenlignes med et andre bilde, gir fire distinkte populasjoner som hver tilsvarer en nukleotid. Basebetegnelse bestemmer hvilken populasjon hver klynge tilhører.

Figur 10 Visualisering av klyngeintensiteter

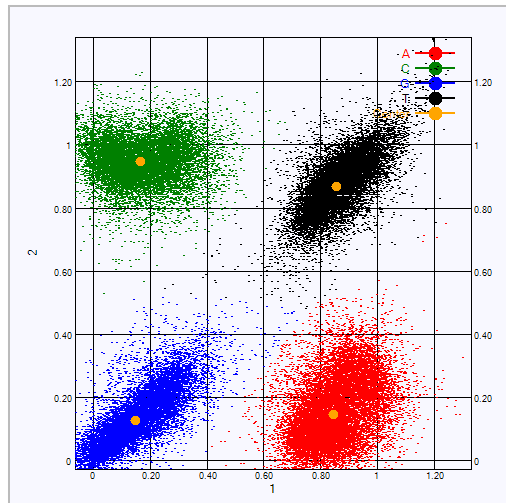

Tabell 3 Basebetegnelse i sekvensering med ett fargestoff

| Base | Fargestoff i første bilde | Fargestoff i andre bilde | Konklusjon fra sammenlignede bilder                               |
|------|---------------------------|--------------------------|---|
| T    | På                        | På                       | Klynger som viser intensitet i begge bilder er T-baser.           |
| A    | På                        | Av                       | Klynger som kun viser intensitet i det første bildet, er A-baser. |
| C    | Av                        | På                       | Klynger som kun viser intensitet i det andre bildet, er C-baser.  |
| G    | Av                        | Av                       | Klynger som viser intensitet i ingen av bildene, er G-baser.      |

## Klyngepasserende filter

Under kjøringen filtrerer RTA2 rådata for å fjerne avlesninger som ikke oppfyller datakvalitetsterskelen. Overlappende klynger og klynger av lav kvalitet, fjernes.

Når det gjelder sekvensering med ett fargestoff, bruker RTA2 et utfyllingsbasert system for å bestemme renheten (intensitetrenhetsmåling) for en basebetegnelse. Klynger passerer filter (PF) når ikke mer enn én basebetegnelse i de første 25 syklusene har en renhet under en fast terskel.

PhiX-innretting utføres ved syklus 26 på et delsett med fliser for klynger som passerte filter. Klynger som ikke passerer filter basebetegnes ikke, og justeres ikke.

## Indeksavlesninger

Prosessen for basebetegnelsesindeksavlesninger avviker fra basebetegnelsessekvenseringsavlesninger. De første to syklusene av en indeksavlesning kan ikke starte med to G-baser, fordi intensitet da ikke genereres. Hvis du vil sikre demultipleksytelse, må intensitet finnes i en av de første to syklusene.

Kontroller at *minst* én indeksadaptersekvens i en biblioteksammenslåing ikke starter med to G-baser. Velg balanserte indeksadaptersekvenser slik at det finnes signal i minst ett bilde (helst begge bildene) for hver syklus. Plateoppsettet og sekvensene som du finner i IDT for Illumina TruSeq UD-indekser er utformet for å ha riktig balanse.

Du finner mer informasjon om indeksering og sammenslåing i *Sammenslåingsveiledning for indeksadapter* (dokumentnr. 1000000041074).

## Kvalitetsscoring

En kvalitetsscore, eller Q-score, er en prediksjon av sannsynligheten for en feil basebetegnelse. En høyere Q-score innebærer at en basebetegnelse har høyere kvalitet og mer sannsynlig å være korrekt.

Q-score er en kompakt måte å kommunisere sannsynligheter for små feil. Q(X) representerer kvalitetsscorer, hvor X er scoren. Følgende tabell viser forholdet mellom kvalitetsscore og sannsynlighet for feil.

| Q-score Q(X) | Sannsynlighet for feil |
|--------------|------------------------|
| Q40          | 0,0001 (1 av 10 000)   |
| Q30          | 0,001 (1 av 1 000)     |
| Q20          | 0,01 (1 av 100)        |
| Q10          | 0,1 (1 av 10)          |



### MERK

Kvalitetsscoring er basert på en endret versjon av Phred-algoritmen.

Kvalitetsscoring beregner et sett med prediktorer for hver basebetegnelse, og bruker deretter prediktorverdiene for å slå opp Q-scoren i en kvalitetstabell. Kvalitetstabeller opprettes for å gi optimalt nøyaktige kvalitetsprediksjoner for kjøringene som er generert av en spesifikk konfigurering av sekvenseringsplattform og kjemiversjon.

Etter at Q-scoren er fastslått, registreres resultater i basebetegnelsesfilene.

# Vedlegg B Feilsøking


|   |    |
|---|----|
| Løse feilmeldinger .....                              | 47 |
| Avbryte en startet kjøring .....                      | 48 |
| Foreta en strømtilstandsending for instrumentet ..... | 48 |
| Utføre en systemkontroll .....                        | 49 |
| Lekkasjebegrensning .....                             | 51 |
| Gjenopprette til fabrikkinnstillinger .....           | 54 |

## Løse feilmeldinger

Dette vedlegget gir detaljert informasjon om diverse prosedyrer for feilsøking. Følgende flytskjema viser arbeidsflyten for feilsøkingsfeilmeldinger som vises under initialisering, kjøring oppsett, kontroller før kjøring eller sekvensering som et nytt forsøk ikke løser.

Mange feil kan løses med en strømtilstandsending: å slå av instrumentet og deretter starte det på nytt igjen. Andre krever en systemkontroll slik at problemet kan diagnostiseres og løses.

Figur 11 Oversikt over feilmeldinger

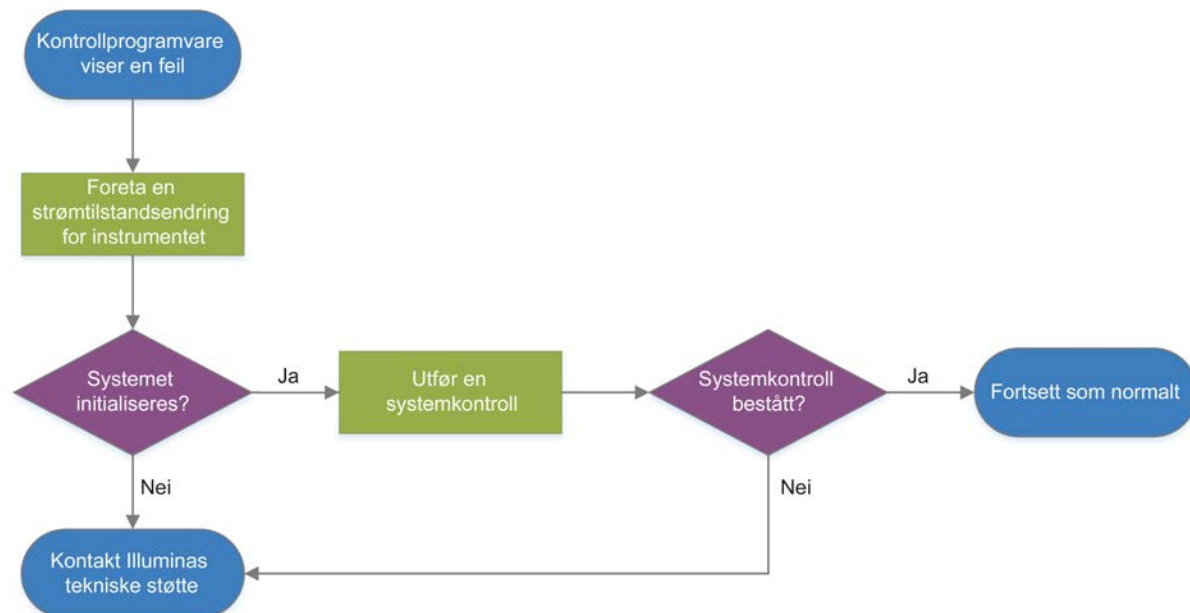

## Status for prosessbehandling

Slik feilsøker du et statusproblem i skjermbildet Process Management (Prosessbehandling):

- ▶ Hvis kjøringen pågår, lukker du skjermbildet Process Management (Prosessbehandling), venter i ca. fem minutter og åpner det på nytt.
- ▶ Hvis ikke kjøringen pågår, foretar du en strømtilstandsending for instrumentet, og deretter åpner du skjermbildet Process Management (Prosessbehandling) på nytt. Se *Foreta en strømtilstandsending for instrumentet* på side 48.

## Avbryte en startet kjøring

Etter at en kjøring starter kan du avbryte den for å avslutte kjøringen, støte ut kassetten og gå tilbake til skjermbildet Sequence (Sekvens).



### FORSIKTIG

Å avbryte en kjøring er **endelig**. Programvaren kan ikke gjenoppta kjøringen, og forbruksmaterieil kan ikke brukes på nytt etter instrumentkontrolldelen av kontroller før kjøring.

- 1 Velg **Stop Run** (Stopp kjøring), og velg deretter **Yes, cancel** (Ja, avbryt).  
Skjermbildet Sequencing Canceled (Sekvensering avbrutt) vises med tidsangivelser av datoen og klokkeslettet da kjøringen stoppet.
- 2 Åpne døren og støt ut brettet ved å trykke på **Eject Cartridge** (Støt ut kasset).  
3 Fjern kassetten fra brettet.
- 4 Ta vare på eller kast kassetten, avhengig av når avbrytelsen skjedde:

| Forhold  | Instruksjon   |
|--|---|
| Du avbrøt før eller under instrumentkontrollen, og ønsker å bruke forbruksmaterieil på nytt. | La strømningscellen og biblioteket bli i kassetten, og sett den til side ved romtemperatur i opptil 1 time.   |
| Alle andre forhold.  | Fjern strømningscellen fra kassetten. Avhend begge komponenter i henhold til gjeldende lokale standarder. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strømningscellen har elektroniske komponenter.</li> <li>• Kassetten inneholder brukte reagenser og bibliotek.</li> </ul> |


- 5 Last inn brettet på nytt og gå tilbake til skjermbildet Sequencing (Sekvensering) ved å velge **Close Door** (Lukk dør).  
Sensorer bekrefter at kassetten er tatt ut.

## Foreta en strømtilstandsending for instrumentet

Hvis du foretar en strømtilstandsending for instrumentet, kan systemet trygt avsluttes og startes på nytt for å gjenopprette en tapt tilkobling, justere en spesifikasjon eller løse en initialiseringsfeil. Programvaremeldinger angir når du skal foreta en strømtilstandsending for å løse en feil eller advarsel.

- 1 Velg **Shut Down System** (Avslutt system) i menyen.
- 2 Hvis ikke systemet avsluttes, trykker du på og holder inne av/på-knappen på venstre side av instrumentet til lyset tones ned.
- 3 Når av/på-knappen pulserer, trykker du på av-siden (**O**) av vekslebryteren på baksiden.  
Det kan hende at av/på-knappen fortsetter å pulsere etter at strømmen er slått av.

**Figur 12** Veksleknappens plassering

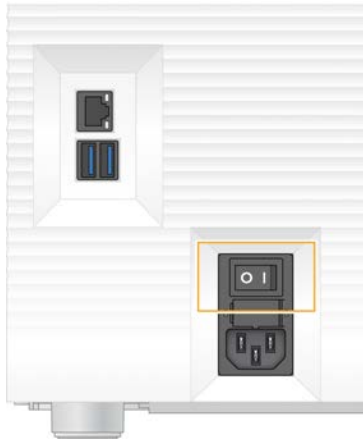

- 4 Vent i 30 sekunder.
- 5 Trykk på på-siden (I) av vekslebryteren.
- 6 Når av/på-knappen pulserer, trykker du på den.

**Figur 13** Av/på-knappens plassering



- 7 Når operativsystemet er lastet, logger du deg på Windows.  
Kontrollprogramvaren startes og initialiserer systemet. Startskjermbildet vises når initialiseringen er fullført.

## Utføre en systemkontroll

En systemkontroll tar omkring 45 minutter, og bruker teststrømningscellen til flergangsbruk og testkassetten til flergangsbruk når feil knyttet til kontroller før kjøring og andre problemer skal feilsøkes. Fire delsystemtester bekrefter om komponenter er riktig innrettet og fungerer som de skal.

Normal drift og vanlig vedlikehold krever ikke en systemkontroll.

- 1 Ta teststrømningscellen til flergangsbruk og testkassetten til flergangsbruk ut av oppbevaring ved romtemperatur.



- 2 I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Check** (Systemkontroll). Dialogboksen System Check (Systemkontroll) vises med de mekaniske, termiske, optiske og sensortestene valgt.
- 3 Åpne kassettkammerdøren og støt ut brettet ved å velge **Unload** (Last ut).
- 4 Hvis det står i en brukt kassett, fjerner du den fra brettet.
- 5 Undersøk glassoverflaten på strømningscellen til flergangsbruk med tanke på synlig smuss. Hvis du ser smuss, rengjør du på følgende måte.
  - a Rengjør glassoverflaten med en alkoholserviett.
  - b Tørk med en laboratorieserviett med lavt loinnhold.
  - c Kontroller at strømningscellen er fri for lo og fibre.

Under normale forhold er det ikke nødvendig å rengjøre teststrømningscellen til flergangsbruk.

- 6 Hold teststrømningscellen til flergangsbruk i gripepunktene med etiketten vendt opp.
- 7 Plasser teststrømningscellen til flergangsbruk i sporet på forsiden av testkassetten til flergangsbruk. Det høres et klikk som angir at strømningscellen er på plass. Når kassetten er lastet riktig inn, stikker grepet frem fra kassetten, og glasset er synlig fra tilgangsvinduet.



- a Innlasting av teststrømningscellen til flergangsbruk
  - b Innlastet teststrømningscelle til flergangsbruk
- 8 Plasser testkassetten til flergangsbruk på brettet slik at tilgangsvinduet vender opp og strømningscellen er inne i instrumentet.



- 9 Velg **Load** (Last inn) for å laste inn testkassetten til flergangsbruk og lukke døren.

- 10 Start systemkontrollen ved å velge **Start**.  
Under systemkontrollen vil programvaren støte ut og trekke inn kassetten én gang.

**MERK**

Teststrømningscellen og kassetten til flergangsbruk er gyldig for 36 gangers bruk eller i 5 år fra produksjonsdatoen, alt etter hva som nås først. Gjenværende antall ganger bruk vises på skjermen.

- 11 Når systemkontrollen er fullført, går du gjennom hver test for å se om den er bestått.

| Resultat                    | Angivelse  | Tiltak  |
|-----------------------------|--|---|
| Alle fire tester er bestått | Instrumentet fungerer som det skal, og problemet er sannsynligvis knyttet til forbruksmateriell eller bibliotek. | Konfigurer en ny kjøring. Hvis du tok vare på forbruksmateriell fra den forrige kjøringen, bruker du det til den nye kjøringen. |
| Minst én test besto ikke    | Instrumentet kan ha en maskinvarefeil.   | Kontakt Illuminas tekniske støtte.  |

- 12 Støt ut testkassetten til flergangsbruk ved å velge **Unload** (Last ut).  
 13 Fjern testkassetten til flergangsbruk fra brettet.  
 14 Fjern teststrømningscellen til flergangsbruk fra kassetten.  
 15 Legg testkomponentene til flergangsbruk tilbake i originalemballasjen, og oppbevar dem ved romtemperatur.  
 16 Lukk dialogboksen System Check (Systemkontroll).

## Lekkasjebegrensning

Ved en dårlig væsketilkobling, et kassettpproblem eller hvis det påvises en lekkasje under en kontroll før kjøring eller sekvensering, avslutter programvaren kjøringen og varsler deg. Etter at du har vurdert lekkasjen og rengjort instrumentet, bekrefter en systemkontroll at normal drift kan fortsette.

Et dryppbrett ved instrumentets sokkel fanger opp væske som lekker fra kassetten. Lekket væske kan imidlertid nå andre områder av systemet. Under normale forhold er dryppbrettet tørt.

## Vurdere lekkasjen

- 1 Ta på et nytt par pudderfrie hansker.

**ADVARSEL**


Dette reagenssettet inneholder potensielt farlige kjemikalier. Personskade kan forekomme ved innånding, svelging, hudkontakt og øyekontakt. Bruk verneutstyr, inkludert vernebriller, hansker og laboratoriefrakk som er egnet ved risiko for eksponering. Brukte reagenser skal behandles som kjemisk avfall og kastes i samsvar med gjeldende regionale, nasjonale og lokale lover og forskrifter. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om helse, miljø og sikkerhet, kan du se mer på [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).

- 2 Følg ledeteksten i skjermbilder for å støte ut kassetten.  
 3 Undersøk kassetten med tanke på synlig væske.  
 En liten mengde væske (< 500 µl) på strømningscellens glassoverflate er akseptabelt.  
 4 Hvis du ikke ser noe væske (eller en akseptabel væskemengde), går du videre til *Rengjøre instrumentet*. Etter rengjøring bekrefter en systemkontroll normal drift.


- 5 Hvis en betydelig væskemengde er synlig på strømningscellen, kassetten eller instrumentet, avslutter du og kobler fra som beskrevet og kontakter Illuminas tekniske støtte.
  - a Velg **Shut Down System** (Avslutt system) i menyen.
  - b Hvis kommandoen for å avslutte ikke svarer, trykker du på og holder inne av/på-knappen på venstre side av instrumentet til lyset tones ned.
  - c Når av/på-knappen pulserer, trykker du på av-siden (**O**) av vekslebryteren på baksiden av instrumentet.
  - d Vent i 30 sekunder.
  - e Koble strømføringen fra stikkontakten, og deretter fra vekselstrømuttaket på baksiden.
  - f Hvis det er aktuelt, kobler du Ethernet-kabelen fra stikkontakten, og deretter fra Ethernet-porten på baksiden.

## Rengjøre instrumentet

- 1 Slå for sikkerhets skyld av og koble fra instrumentet:
  - a Velg **Shut Down System** (Avslutt system) i menyen.
  - b Hvis kommandoen for å avslutte ikke svarer, trykker du på og holder inne av/på-knappen på venstre side av instrumentet til lyset tones ned.
  - c Når av/på-knappen pulserer, trykker du på av-siden (**O**) av vekslebryteren på baksiden av instrumentet.
  - d Vent i 30 sekunder.
  - e Koble strømføringen fra stikkontakten, og deretter fra vekselstrømuttaket på baksiden.
  - f Hvis det er aktuelt, kobler du Ethernet-kabelen fra stikkontakten, og deretter fra Ethernet-porten på baksiden.
- 2 Finn dryppbrettet under kassettkammeret på forsiden av instrumentet, og senk deretter døren.

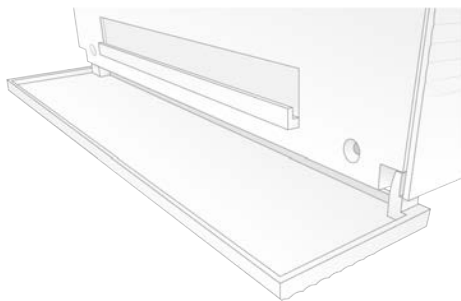

- 3 Åpne dryppbrettet, og fjern dryppbrettputen.

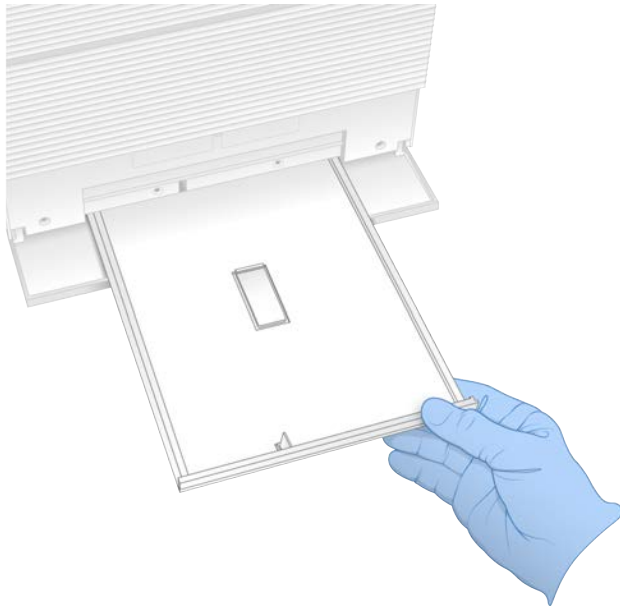

- 4 Tørk bort eventuell restvæske fra bunnen av brettet med tørkepapir.
- 5 Kast puten og annet forbruksmaterieill i henhold til gjeldende standarder, som kan variere fra sted til sted. Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet på [support.illumina.com/sds.html](https://support.illumina.com/sds.html).
- 6 Plasser en ny pute på dryppbrettet.
- 7 Lukk dryppbrettet, og lukk deretter dryppbrettdøren.
- 8 Tørk bort eventuell synlig væske på eller rundt instrumentet med tørkepapir.
- 9 Slå på og koble instrumentet til på nytt på følgende måte.
- Hvis det er aktuelt, kobler du Ethernet-kabelen til en Ethernet-port.
  - Koble strømledningen til strøminntaket på baksiden og deretter til en stikkontakt.
  - Trykk på på-siden (I) av vekslebryteren på baksiden.
  - Når av/på-knappen pulserer, trykker du på den.
  - Når operativsystemet er lastet, logger du deg på Windows.

Kontrollprogramvaren startes og initialiserer systemet. Startskjermbildet vises når initialiseringen er fullført.

- 10 Ved hjelp av en systemkontroll bekrefter du at systemet fungerer som det skal. Hvis instrumentet består systemkontrollen, kan du bruke det som normalt. Du finner instruksjoner under *Utføre en systemkontroll på side 49*.

## Gjenopprette til fabrikkinnstillinger

Gjenoprett systemet til fabrikkinnstillinger når du vil nedgradere programvaren, gjenopprette fra en uønsket konfigurasjon eller fjerne brukerdata før du returnerer et instrument til Illumina. Når du gjenoppretter systemet, avinstalleres kontrollprogramvare, og stasjon C tømmes.

- 1 Hvis referansegenomdatabasen for Local Run Manager befinner seg på stasjon C:
  - a Flytt databasen til D:\Illumina\Genomes eller en annen lokal mappe eller nettverksmappe som ikke er på stasjon C.
  - b I Local Run Manager tilbakestiller du databasebanen til D:\Illumina\Genomes eller en annen lokal mappe eller nettverksmappe som ikke er på stasjon C. Du finner instruksjoner i *Veiledning for Local Run Manager-programvare (dokumentnr. 1000000002702)*.
- 2 Start Windows på nytt.
- 3 Når du blir bedt om å velge et operativsystem, velger du **Restore to Factory Settings** Gjenoprett til fabrikkinnstillinger.  
Operativsystemalternativene vises et kort øyeblikk før det automatisk fortsettes med iSeq-kontrollprogramvare.
- 4 Vent i ca. 30 minutter mens gjenopprettingen fullføres.  
Gjenopprettingen kan innbefatte flere omstarter. Når den er fullført, starter systemet på nytt med de opprinnelige fabrikkinnstillingene, uten kontrollprogramvaren.
- 5 Installer kontrollprogramvaren:
  - a Last ned installasjonsprogrammet for programvare fra støttesidene for iSeq 100-sekvenseringssystem. Lagre installasjonsprogrammet til en nettverks plassering eller bærbar USB-stasjon.
  - b Kopier installasjonsprogrammet til C:\Illumina.
  - c Åpne **iSeqSuiteInstaller.exe**, og gjør det du blir bedt om for å utføre installasjonen.
  - d Når oppdateringen er fullført, velger du **Finish** (Fullfør).
  - e Foreta en strømtilstandsending for instrumentet. Du finner instruksjoner i *Foreta en strømtilstandsending for instrumentet på side 48*.
- 6 Følg meldingene i skjermbildet når du skal utføre førstegangs oppsett, deriblant systemkontrollen med testkassetten for flergangsbruk og teststrømningscellen for flergangsbruk.
- 7 Installer eventuelle Local Run Manager-analysemoduler:
  - a Bytt til sbsadmin-operativsystemkontoen.
  - b Last ned installasjonsprogrammene for programvare fra støttesidene for Local Run Manager. Lagre installasjonsprogrammene til en nettverks plassering eller bærbar USB-stasjon.
  - c Kopier installasjonsprogrammet til C:\Illumina.
  - d Åpne installasjonsprogrammet (\*.exe), og gjør det du blir bedt om for å utføre installasjonen.
  - e Når oppdateringen er fullført, velger du **Finish** (Fullfør).

# Vedlegg C Avansert bytte

|  |    |
|--|----|
| Bytte iSeq 100-systemet .....                    | 55 |
| Motta et erstatningssystem .....                 | 55 |
| Klargjøre det originale systemet for retur ..... | 55 |
| Returnere det originale systemet .....           | 58 |

## Bytte iSeq 100-systemet

Ettersom luftfilteret og dryppbrettputen er de eneste delene som kan repareres i iSeq 100-systemet, bruker Illumina avansert bytte for å utbedre problemer som ikke kan løses eksternt.

Avansert bytte erstatter et skadet eller defekt system med et renvert system. Du vil motta erstatningssystemet før du sender originalen tilbake slik at nedetiden minimeres.

## Regional tilgjengelighet

Avansert bytte er tilgjengelig i de fleste regioner. Andre regioner kan fortsette å motta støtte fra serviceingeniører. Spør Illuminas tekniske støtte om hvilke støttemodeller som er tilgjengelige i regionen din.

## Motta et erstatningssystem

- 1 Etter at en systemkontroll og andre forsøk på feilsøking har mislyktes, kontakter du Illuminas tekniske støtte.
  - ▶ Om mulig kan du utføre en ny systemkontroll med en annen testkassett til flergangsbruk og teststrømningscelle til flergangsbruk.
  - ▶ Gjør resultatene av systemkontrollen tilgjengelige for teknisk støtte.Hvis den tekniske støtten ikke kan løse problemet eksternt, iverksettes en retur, og det legges inn en bestilling på et erstatningssystem.
- 2 Når du mottar erstatningssystemet:
  - ▶ Pakk ut og installer i henhold til *Oppsettplakat for iSeq 100-sekvenseringssystem (dokumentnr. 1000000035963)*.
  - ▶ **Ta vare på all emballasjen** som brukes til å emballere det originale systemet og testkomponentene til flergangsbruk for retur.
  - ▶ Legg til side returdokumentene, som omfatter en UPS-returetikett og handelsfaktura (for internasjonale forsendelser).

## Klargjøre det originale systemet for retur

Returner det originale systemet, testkassetten til flergangsbruk og teststrømningscellen til flergangsbruk til Illumina innen 30 dager etter at du har mottatt erstatningsproduktet.

## Avslutte og koble fra


Hvis systemet er på, følger du trinn – slik at data lagres og fjernes før systemet avsluttes på en sikker måte. Følg resten av trinnene for å fjerne en kassett (ved behov) og koble fra ledninger og kabler.

- 1 I Filutforsker kopierer du eventuelle filer og mapper som du vil lagre til en bærbar USB-stasjon. Plasseringen til sekvenseringsdata er brukerdefinert, men **stasjon D** er standardplasseringen.
- 2 Slett eventuelle filer og mapper som du ikke vil dele med Illumina.

- 3 Avslutt systemet på følgende måte.
  - a Velg **Shut Down System** (Avslutt system) i menyen.
  - b Hvis kommandoen for å avslutte ikke svarer, trykker du på og holder inne av/på-knappen på venstre side av instrumentet til lyset tones ned.
  - c Når av/på-knappen pulserer, trykker du på av-siden (**O**) av vekslebryteren på baksiden av instrumentet.
- 4 Hvis det står en kassett i instrumentet, starter du systemet på nytt og fjerner kassetten på følgende måte.
  - a Trykk på på-siden (**I**) av vekslebryteren på baksiden.
  - b Når av/på-knappen pulserer, trykker du på den.
  - c Når operativsystemet er lastet, logger du deg på Windows.
  - d I kontrollprogramvaremenyen velger du **System Check** (Systemkontroll).
  - e Støt ut kassetten ved å velge **Unload** (Last ut), og deretter fjerner du kassetten fra brettet.
  - f Hvis utstøtingen mislykkes, må du kontakte Illuminas tekniske støtte for nærmere instruksjoner.
  - g Velg **Load** (Last inn) slik at det tomme brettet trekkes inn og døren lukkes.
  - h Lukk avmerkingsboksen System Check (Systemkontroll), og deretter avslutter du systemet.

Det er nødvendig å avslutte og starte systemet på nytt for å posisjonere kassetten for fjerning.

- 5 Koble strømledningen fra stikkkontakten, og deretter fra vekselstrømuttaket på baksiden.

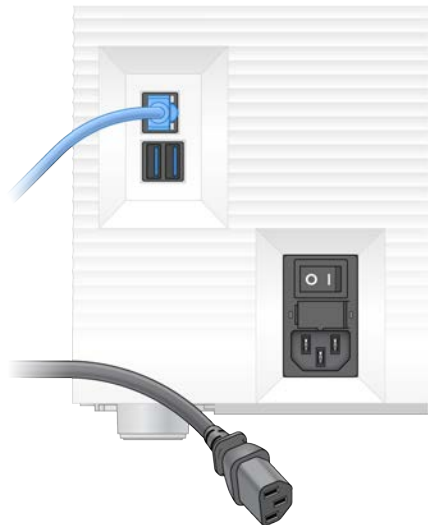

- 6 Hvis det er aktuelt, kobler du:
  - ▶ Ethernet-kabelen fra stikkkontakten, og deretter fra Ethernet-porten på baksiden.
  - ▶ tastaturet og musen fra USB-portene på baksiden.

## Dekontaminere instrumentet

Når et instrument skal sendes, må det gjennom følgende dekontamineringsprosedyre, som Illumina bekrefter er komplett. Stedsspesifikke farer kan kreve ekstra dekontaminering.


### Dekontaminere med klor

- 1 Ta på et nytt par puddefrie hansker.

- 2 Senk instrumentets monitor.
- 3 Dra kassettkammerdøren forsiktig fra sidekantene for å åpne den.




- 4 Rengjør hele kammerdøren med en klorserviett:
  - ▶ Dørens innside
  - ▶ Dørens utside
  - ▶ Dørhengslene
- 5 Lukk kassettkammerdøren.
- 6 Finn dryppbrettdøren under kassettkammeret på forsiden av instrumentet, og senk deretter døren.

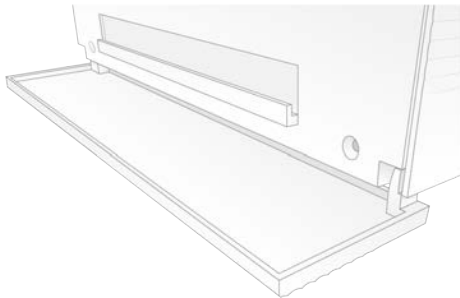



- 7 Åpne dryppbrettet, og fjern dryppbrettputen.

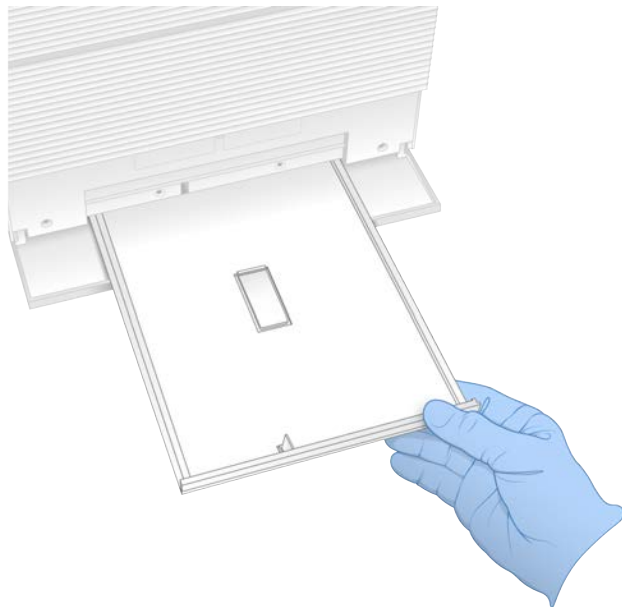

- 8 Tørk bort eventuell restvæske fra bunnen av brettet med tørkepapir.
- 9 Kast puten og annet forbruksmateriell i henhold til gjeldende standarder, som kan variere fra sted til sted. Du finner mer informasjon i sikkerhetsdatabladet på [support.illumina.com/sds.html](https://support.illumina.com/sds.html).
- 10 Rengjør dryppbrettet med en klorserviett.
- 11 Vent i 15 minutter slik at klorene får virke.

## Nøytralisere med alkohol

- 1 Fukt en klut eller tørkepapir med vann.  
Du kan bruke alle typer vann, også springvann.
- 2 Tørk over følgende komponenter med den fuktige kluten eller tørkepapir:
  - ▶ Dryppbrett
  - ▶ Kassettkammerdør (innvendig og utvendig, inkludert hengsler)Vannet forhindrer at klor og alkohol blandes.
- 3 Rengjør følgende komponenter på nytt med en alkoholserviett:
  - ▶ Dryppbrett
  - ▶ Kassettkammerdør (innvendig og utvendig, inkludert hengsler)Alkoholen fjerner rester av klor, som kan forårsake korrosjon.
- 4 Kontroller at dryppbrettdøren og kassettkammerdøren er lukket.
- 5 Rengjør laboratoriebenken rundt instrumentet med klorservietter eller kloropløsning.

## Returnere det originale systemet


### Emballere instrumentet

- 1 Gjør klar tilstrekkelig plass i laboratoriet til instrumentet og emballasjen.

- 2 Plasser den lille skumputen mellom den senkede monitoren og instrumentet.
- 3 Plasser den grå plastposen over instrumentet.



- 4 Senk den fremre klaffen på den hvite esken.
- 5 Plasser instrumentet i den hvite esken slik at forsiden av instrumentet vender mot deg.
- 6 Plasser den firkantede skumbiten over instrumentet slik at de tynnere sidene av skumbiten hviler mot forsiden og baksiden av instrumentet. Kontroller at skumbiten er i flukt med toppen av esken.

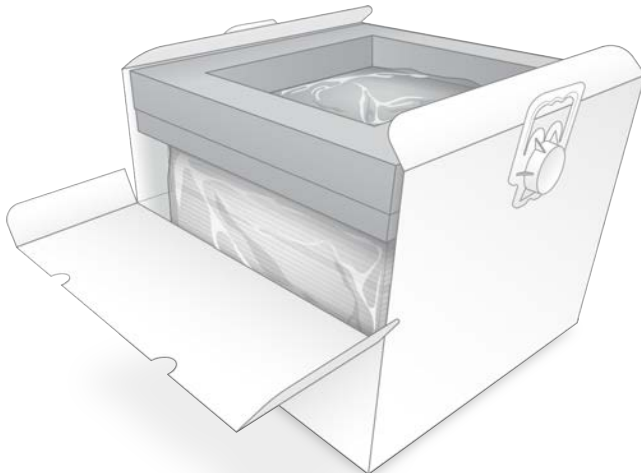

- 7 Lukk den fremre klaffen, og lukk deretter toppen av esken.

## Emballere testkomponentene til flergangsbruk


- 1 Plasser iSeq 100 i1-testkassetten til flergangsbruk i den største gjenlukkbare posen, og forsegl den.
- 2 Plasser iSeq 100 i1-teststrømningscellen til flergangsbruk i oppbevaringskofferten.
- 3 Plasser kofferten i den minste gjenlukkbare posen, og forsegl den.
- 4 Plasser begge de gjenlukkbare posene i tilbehøresken for iSeq 100-sekvenseringssystem.



- 5 Lukk tilbehørsesken.

## Sende systemet

- 1 Hvis den ble fjernet, plasserer du den beskyttende skumbasen i bunnen av den brune fraktesken.

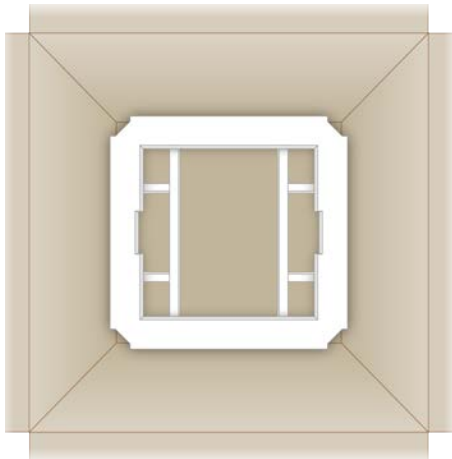


- 2 Løft den hvite esken etter håndtakene (det anbefales at to personer løfter sammen), og senk deretter den hvite esken ned i den brune esken. Den kan plasseres i hvilken som helst retning.



### FORSIKTIG

Den hvite esken må sendes inni den brune esken. Den hvite esken er ikke utformet eller merket for forsendelse.

- 3 Plasser det beskyttende skumløkket over den hvite esken.
- 4 Plasser tilbehørseskene i midten av skumløkket.
- 5 Plasser den svarte skumputen oppå tilbehørseskene.
- 6 **[Valgfritt]** Plasser Ethernet-kabelen og strømledningen hvor som helst i den brune esken.
- 7 Lukk den brune esken, og forsegle den med fraktteip.
- 8 Plasser returetiketten over den opprinnelige forsendesetiketten, eller fjern den opprinnelige forsendesetiketten.

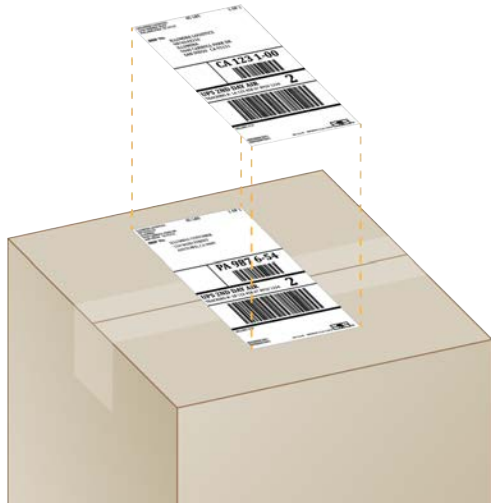

- 9 **[Internasjonal forsendelse]** Fest handelsfakturaen til fraktesken.
- 10 Send instrumentet til Illumina via UPS.
  - ▶ Hvis laboratoriet har en daglig leveringsavtale med UPS, leverer du den adresserte fraktesken til sjåføren.
  - ▶ Hvis laboratoriet ikke har en daglig leveringsavtale med UPS, varsler du Illuminas kundetjeneste slik at de kan planlegge returforsendelsen for deg.

# Indeks

## %

% fyllingsgrad 28, 31  
% klynge-PF 28, 31  
% PF 20, 28, 31  
%PF 45

## A

adapteralternativer, Wi-Fi 17  
adaptersekvenser 14, 29  
administratorkonto 11, 39  
advarsler 6, 43, 48  
alkoholservietter 18  
alternativer for dataanalyse 12-13  
AmpliSeq Library PLUS for Illumina 20  
analyse  
    fremgangsmåter 5, 20  
    status 7  
    utenfor instrument 20  
    utforming 1  
analyse utenfor instrumentet 20  
arbeidsgrupper 27, 30  
audioinnstillinger 15  
automatisk kjørsstart 28, 31  
automatiske oppdateringer 33  
av/på-knapp 3, 37, 48  
avbildning 20  
avlesningslengder 21  
avlesningssykluser 30  
avlesningstyper 21, 30  
avslutte 37, 48, 52, 56  
avslutte kjøring 48

## B

baner, strømningscelle 8  
basebetegnelse 5, 20, 45  
basebetegnelsesfiler 20, 41  
basediversitet 45  
baser, datakoding 44  
BaseSpace Sequence Hub 1  
    filopplasting 7  
    hurtiginstillinger 12  
    krav til prøveark 14  
BCL-filer 6, 41  
bcl2fastq2-konverteringsprogramvare 41  
bestå systemkontroll 49  
bibliotekbeholder 24

biblioteker 1, 8, 20  
    kompatible 23  
    oppbevare 1 nM 22  
    startkonsentrasjoner 22  
biblioteker.denaturere 20  
bibliotekklargjøringssett 1, 20  
bildeanalyse 5  
bilder 15, 41, 43-44  
bleke 56  
blekemiddelservietter 18  
brett 4  
brukerkonto 11  
brukte reagenser 4, 8

## C

Chromium  
    tom skjerm 26  
    åpne 26  
CMOS-sensorer 8, 25, 42

## D

datamaskinnavn 6  
datasletting 55  
delenumre 9  
deler som kan repareres 55  
delsystemer 49  
demping 15  
demultipleksingsytelse 45  
denaturere 20  
denatureringsbiblioteker 20, 22  
DesignStudio 1  
diagnostikk 49  
diskplass 6, 33  
dobbeltstrengede biblioteker 22  
dokumentasjon 1, 68  
domener 13  
dryppbrett 51  
    dør 52, 57  
    plassering 52, 57  
    puter 18, 55  
dører 56  
    lukke 26, 29  
    utforming 4

## E

EEPROM 7

- ekstern tilgang 26
- eksterne stasjoner 16
- ekstra sykluser 21
- elektrisk grensesnitt 8, 25
- elektronisk avfall 29, 32, 48
- emballasje 22
  - avhende 22
  - avhending 25
  - kassett 21
  - returforsendelser 55
  - strømningscelle 25
  - åpne 22
- enkel avlesning 27, 30
- Enterprise-abonnementer 13
- erstatning 17
- Ethernet 3, 36
- Ethernet-kabel 52, 55
- Ethernet-port 52, 55
- Ethernet, slå på 17

## F

- fabrikkinnstillinger 54
- fanen Customization (Tilpasning) 11, 14
- fanen Network Access (Nettverkstilgang) 11, 16
- fanen Settings (Innstillinger) 11-12
- farlige kjemikalier 9, 29, 32
- fasing 44
- fasing og prefasing 21
- FASTQ-filer 29, 41
- fastvareoppdateringer 34
- feil 6, 43, 48
  - meldinger 47
  - sannsynlighet 46
- filkonvertering 41
- filterfiler 41
- filtrere klynger 45
- fjernovervåking 27, 30
- fliser 41
- flytte 3, 36
- forbruksmateriell
  - avhending 29, 32
  - bruke på nytt 28, 31
  - emballasje 9
  - skanning 26, 29
  - spore 1, 7
- forbruksmateriellkammer 3
- formamid 29, 32
- forsendelsesetiketter 60
- forsterkning 20
- fortynne biblioteker 20

- fryse/tine-sykluser 21
- frysespesifikasjoner 18
- fyllingsgrad 20
- førstegangs oppsett 35, 54

## G

- G-baser 45
- garanti 18
- gjenoppta kjøring 48
- GPO 38
- gripepunkter 8, 25
- gruppepolicyobjekt 38

## H

- handelsfaktura 60
- harddisk 6, 33
- Hjelp-ikon 29
- hjelp for Windows 10 17
- hjelp, teknisk 68
- hvit eske 58
- hviteliste, SRP 38

## I

- i5-indeksadaptere 30
- i5-retninger 29
- i7-indeksadaptere 30
- IDT for Illumina TruSeq UD-indeks 45
- ikke bestå systemkontroll 49
- ikoner 6, 9
- ikonet hjelp 26
- Illumina proaktiv støtte 12-13
- illuminator 8
- indeks 2-retninger 29
- indekser
  - adaptersekvenser 45
  - avlesninger 30
  - sykluser 9, 21
- initialisere 53
- initialisering 37, 49
  - feil 48
- innlastingsretning 26, 29
- innstillinger
  - førstegangs oppsett 11
  - redigering 12-13
- innstillinger for hurtigoppsett 12
- installasjonsprogram for System Suite 33
- installere programvare 33

- instrument
  - installasjon 55
  - vekt 36
- instrumentkontroll 28, 31
- intensiteter 44
- internasjonale forsendelser 60
- interne stasjoner 16
- InterOp-filer 41
- IP-adresser 6
- iSeq 100 i1-reagenser 7, 17

## K

- kallenavn 15
- kassett 22, 26, 29, 48
  - avhending 29, 32, 48
  - emballasje 21-22
  - oppbevare 7
  - sitte fast i instrument 55
- kassett som sitter fast 55
- kassettbrett 4
- katalognumre 17
- kjøleskapsspesifikasjoner 18
- kjør oppsett
  - konfigurasjonsalternativer 13
- kjøringer 33
  - kontrollere status 6, 28, 31
  - lagre i BaseSpace Sequence Hub 12
  - lagring i BaseSpace Sequence Hub 13
  - overvåking i BaseSpace Sequence Hub 12-13
  - redigere parametere 27
  - størrelse på 15
  - telle 6, 42
- kjøringsmappe 16, 33, 42
- kjøringsnavn 30
- kjøringsoppsett 26
  - konfigurere alternativer 12
  - skjermbilder 29
- klargjøre sted 16, 36
- klargjøring av sted 2, 58
- klargjøringsvideo 22
- klyngeplasseringer 41
- klynger 20
  - filtrere 45
- koble fra 52
- koble til på nytt 53
- kommandolinjer 17
- kompatible biblioteker 23
- konfigurasjonsfiler 41
- konfigurasjonsinnstillinger 43

- kontotyper 11
- kontrollbiblioteker 11
- kontrollfeil før kjøring 49
- konvertere filer 41
- korrosjon, forhindre 58
- kundestøtte 68
- kvalitetskontroll, biblioteker 22
- kvalitetsscorer 20
- kvalitetstabeller 46
- kvalitetsterskler 45

## L

- labfrakk 21
- lastekonsentrasjoner 20, 23
- lekkasje 51
- Local Run Manager 5
  - dokumentasjon 1, 27
  - ekstern tilgang 26
  - hurtiginnstillinger 12
  - moduler 33
  - nedlastinger 33
  - opprette kjøring 26
  - prøveark
    - opprette 14
  - status 7
  - veiledninger for arbeidsflyt 27
- Local Run Manager-modus, om 26
- loggfiler 43
- lokal analyse 1
- lokaliserte innstillinger 12-13
- lotnumre 9
- luftfiltre 55
  - ekstra 18
  - plassering 35
- lydinnstillinger 14-15
- lyslinje 3

## M

- maksimalt antall sykluser 21
- maksimere kontrollprogramvare 11
- mal, prøveark 14
- maler, prøveark 29
- Manuell modus
  - FASTQ-filer 41
  - om 29
- manuell modus, FASTQ-filer 29
- manuelle programvareoppdateringer 33
- mikrorør med lav binding 22
- miniatyrbilder 15

miniatyrbilder, lagre 14  
minste antall sykluser 21  
monitor 3  
mus 3, 11  
mønstrede strømningceller 8

## N

nanobrønner 44  
navngi  
    datamaskinnavn 6  
    instrumentkallenavn 15  
    instrumentnavn 14  
    prøveark 14  
nedgradere programvare 54  
nettverk 16  
    retningslinjer 16  
Nextera DNA Flex 20  
Nextera Flex for Enrichment 20  
NGS 1  
normaliseringsmetoder 22  
nukleotider 20, 44

## O

operativsystem 37, 49, 53  
oppbevare 48  
    fortynnede biblioteker 22  
    reagenssett 7  
oppbevaring 21  
oppbevaringsforhold 7, 9  
oppnå tilgang til 11  
oppsettplakat 2, 55  
oppskrifter, programvare 33  
oppskriftsfragmenter 6  
optimalisere 20  
optimalisere lastekonsentrasjon 20  
optisk sensor 8

## P

paired-end 27, 30  
pakke 60  
pakke ut 55  
pakninger 25  
partikode 9  
passerende filtre 20, 28, 31  
passord  
    endre 11  
    standardpolicyer 11

personlig verneutstyr 21  
PF 45  
PhiX 11, 17-18  
PhiX-innretting 45  
Phred-algoritme 46  
planlagt total produksjonsmetrikk 28, 31  
prefasing 44  
private domener 13  
Process Management (Prosessbehandling) 28,  
    31  
produksjonsmetrikk 28, 31  
produsent 9  
programvare  
    installere 33  
    nedgradere 54  
    oppdatere innstillinger 14-15  
    oppdateringsvarsler 34  
    reagenskompatibilitet 7  
programvareserie 1, 5  
prosent fyllingsgrad 20, 28, 31  
prosess ikke fullført 47  
prosess stoppet 47  
prosessbehandling 33  
prøveark 27, 29-30, 43  
    maler 14, 29  
    navngi 14  
prøvemanifest 43  
puter 18, 52, 57

## Q

Q-scorer 28, 31, 46  
Q30 28, 31

## R

reagenser 7-8  
    avhending 29, 32, 48  
    blande 22  
    oppbevare 7  
    programvarekompatibilitet 7  
reagenssett 7  
redigere kjøringsparametere 27  
rengjøre strømningceller 49  
renhetsmålinger 45  
reovering 55  
reservedeler 35  
resuspensjonsbuffer 17, 22  
rettigheter, administratorkonto 39  
returer  
    dokumenter 55



- frister 55
- returetiketter 60
- RFID 2, 7
- RSB 17
- RSB-erstatning 22
- RunInfo.xml 41
- rør, med lav binding 22

## S

- sammenslåingsveiledning 45
- sbsadmin kontra sbsbruker 11
- sekvensering
  - arbeidsprosess 1
  - avlesninger 9
  - sykluser 9
- sekvensering med ett fargestoff 20, 44-45
- sende systemer i retur 55
- sensorer 48
- Sequencing Analysis Viewer 41
- serienumre 6, 42
- serviceingeniører 55
- sett 7, 17
  - katalognumre 18
- sikkerhet 38
  - tilpasning 39
- sikkerhet og samsvar 2
- sikkerhetsdatablad 29, 32, 51-52, 57
- skjermbilder 26
- skybasert analyse 1
- slette kjøring 6, 33
- slå av 52, 56
- spesifikasjonsinnretting 48
- spore forbruksmateriell 1, 7
- SRP-standarder 38
- standard utdatamappe 16, 27
- standardinnstillinger 16
- starte på nytt 54
- startkonsentrasjoner 22
- stasjon C 16, 54
- stasjon D 6, 16, 33, 55
- statuslinje 3
- stikkontakt 52, 55
- stoppe kjøring 48
- strømledning 3, 36, 52, 55
- strømningscelle 22
- strømningsceller
  - antall sykluser 9
  - avhending 29, 32
  - baner 8
  - oppbevare 7

- strømningskontroll 28, 31
- strømtilstandsending 17, 28, 31, 47
- størrelse på 33
- støttemodeller 55
- støttesider, nettsted 33
- System Settings (Systeminnstillinger) 11, 14
- systemkontroller 47, 51, 53
  - resultater 49
  - varighet 49

## T

- tapte tilkoblinger 48
- tastaturer 3, 11
- teknisk hjelp 68
- testkassett til flergangsbruk 49, 55
- testsett 18
- testsett for iSeq 100-system 18, 49
- teststrømningscelle til flergangsbruk 49, 55
- tilbehørseske 59
- tilgangsvindu, kassett 8
- Tilpasset protokollvelger 2
- tinte kassetter 21
- tom skjerm, Chromium 26
- trinn i instrumentet 20
- TruSeq DNA Nano 20
- TruSeq DNA PCR-Free 20
- TSV-filformat 43
- tørris 21

## U

- Universal Copy Service 5, 7, 16, 33
- UPS 60
- USB-porter 3, 34
- utdatamappe 7, 11, 27, 30, 33, 41
  - standardplassering 16, 42
- utløpsdatoer 9, 35

## V

- vannbad 21
- varsler 33-34
- vasker 8
- vekselstrøm
  - inntak 3
  - uttak 36, 52, 55
- vekslebryter 3, 37, 48
- vekt 36
- vernebriller 21

vertsplasseringer 12-13  
vifter 35  
væsker 8  
væsker, lekkede 51

## W

Wi-Fi, slå på 17  
Windows  
    innstillinger 17  
    konti 11  
    pålogging 37, 49, 53  
    sikkerhet 38  
Windows-oppgavelinje 11

## Y

ytelsesdata 27, 30

## Å

åpne manuelt 56

# Teknisk hjelp

Kontakt teknisk støtte hos Illumina for teknisk hjelp.

Nettsted: [www.illumina.com](http://www.illumina.com)  
E-post: [techsupport@illumina.com](mailto:techsupport@illumina.com)

## Telefonnumre til Illuminas kundestøtte

| Region        | Gratis           | Regionalt      |
|---------------|------------------|----------------|
| Nord-Amerika  | +1.800.809.4566  |                |
| Australia     | +1.800.775.688   |                |
| Belgia        | +32 80077160     | +32 34002973   |
| Danmark       | +45 80820183     | +45 89871156   |
| Finland       | +358 800918363   | +358 974790110 |
| Frankrike     | +33 805102193    | +33 170770446  |
| Hongkong      | 800960230        |                |
| Irland        | +353 1800936608  | +353 016950506 |
| Italia        | +39 800985513    | +39 236003759  |
| Japan         | 0800.111.5011    |                |
| Kina          | 400.066.5835     |                |
| Nederland     | +31 8000222493   | +31 207132960  |
| New Zealand   | 0800 451 650     |                |
| Norge         | +47 800 16836    | +47 21939693   |
| Singapore     | +1.800.579.2745  |                |
| Spania        | +34 911899417    | +34 800300143  |
| Storbritannia | +44 8000126019   | +44 2073057197 |
| Sveits        | +41 565800000    | +41 800200442  |
| Sverige       | +46 850619671    | +46 200883979  |
| Taiwan        | 00806651752      |                |
| Tyskland      | +49 8001014940   | +49 8938035677 |
| Østerrike     | +43 800006249    | +43 19286540   |
| Andre land    | +44 1799 534 000 |                |

Sikkerhetsdatablad – Tilgjengelige på Illuminas nettsted på [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).

Produktdokumentasjon – Tilgjengelig for nedlasting i PDF-format fra Illuminas nettsted. Gå til [support.illumina.com](http://support.illumina.com), velg et produkt, og velg deretter **Documentation & Literature** (Dokumentasjon og litteratur).



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, California, 92122 USA  
+1 800 809 ILMN (4566)  
+1 858 202 4566 (utenfor Nord-Amerika)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com

**Kun til forskningsbruk. Ikke til bruk ved diagnostiske prosedyrer.**

© 2019 Illumina, Inc. Med enerett.

**illumina®**